



# 中华人民共和国国家标准

GB 4789.28—2024

## 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求

2024-02-08 发布

2024-08-08 实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会  
国家市场监督管理总局 发布

目 次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 术语和定义 ..... 1

2.1 质量控制 ..... 1

2.2 培养基和试剂的批次 ..... 1

2.3 培养基和试剂的性能 ..... 1

2.4 培养基 ..... 1

2.5 液体培养基 ..... 1

2.6 固体培养基 ..... 1

2.7 半固体培养基 ..... 1

2.8 运输培养基 ..... 1

2.9 保藏培养基 ..... 2

2.10 悬浮培养基 ..... 2

2.11 复苏培养基 ..... 2

2.12 增菌培养基 ..... 2

2.13 选择性增菌培养基 ..... 2

2.14 非选择性增菌培养基 ..... 2

2.15 分离培养基 ..... 2

2.16 选择性分离培养基 ..... 2

2.17 非选择性分离培养基 ..... 2

2.18 鉴别培养基(特异性培养基) ..... 2

2.19 鉴定培养基 ..... 2

2.20 计数培养基 ..... 2

2.21 参比培养基 ..... 3

2.22 商品化即用型培养基 ..... 3

2.23 商品化脱水合成培养基 ..... 3

2.24 自制培养基 ..... 3

2.25 试剂 ..... 3

2.26 测试菌株 ..... 3

2.27 标准菌株 ..... 3

2.28 标准储备菌株 ..... 3

2.29 储备菌株 ..... 3

2.30 工作菌株 ..... 3

3 培养基及试剂质量保证 ..... 4

3.1 证明文件 ..... 4

3.2 贮存 ..... 4

3.3 培养基的实验室制备 ..... 5

3.4 培养基的使用 ..... 6

3.5 培养基的弃置 ..... 6

4 测试菌株的保藏及使用 ..... 6

4.1 一般要求 ..... 6

4.2 商业来源的测试菌株 ..... 6

4.3 实验室制备的标准储备菌株 ..... 7

4.4 储备菌株 ..... 7

4.5 工作菌株 ..... 7

5 培养基和试剂的质量要求 ..... 7

5.1 基本要求 ..... 7

5.2 微生物学要求 ..... 8

6 培养基和试剂性能测试方法 ..... 8

6.1 非选择性分离和计数固体培养基目标菌生长率定量测试方法 ..... 8

6.2 选择性分离和计数固体培养基测试方法 ..... 9

6.3 非选择性增菌培养基半定量测试方法 ..... 10

6.4 选择性增菌培养基半定量测试方法 ..... 11

6.5 选择性液体计数培养基半定量测试方法 ..... 12

6.6 悬浮培养基和运输培养基定量测试方法 ..... 12

6.7 鉴定培养基测试方法 ..... 13

6.8 实验试剂测试方法 ..... 14

附录 A 培养基性能测试方法流程图 ..... 15

附录 B 培养基不正确配制出现的质量问题及原因分析 ..... 19

附录 C 标准储备菌株和工作菌株制备 ..... 20

附录 D 食品安全微生物检验标准中指定的培养基成分 ..... 22

附录 E 食品安全微生物检验标准中参比培养基的质控标准 ..... 23

附录 F 食品微生物实验室使用培养基和试剂的质量控制标准 ..... 28

附录 G 测试菌株 ..... 56

附录 H 螺旋平板法 ..... 59

## 前 言

本标准代替 GB 4789.28—2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》。

本标准与 GB 4789.28—2013 相比,主要变化如下:

- 增加了附录 E 参比培养基的质控标准及质控菌株一览表;
- 增加了培养基性能测试方法流程图;
- 增加了附录 G 测试菌株中文名、拉丁名及编号一览表;
- 删除了纯化学培养基、未定义和部分定义的化学培养基、确证培养基;
- 修改了部分测试菌株;
- 修改了生产商和实验室使用商品化培养基和试剂的质量控制标准方法;
- 修改了附录 F 的菌株编号和名称。

# 食品安全国家标准

## 食品微生物学检验

### 培养基和试剂的质量要求

#### 1 范围

本标准规定了食品微生物学检验用培养基和试剂的质量要求。  
本标准适用于食品微生物学检验用培养基和试剂的质量控制。

#### 2 术语和定义

##### 2.1 质量控制

为满足质量要求所采取的技术操作和活动。

##### 2.2 培养基和试剂的批次

培养基和试剂完整的可追溯单位,是指在特定的生产周期生产,符合生产质量要求的一定数量的产品,这些产品批号相同。

##### 2.3 培养基和试剂的性能

在一定条件下培养基和试剂对测试菌株的反应。

##### 2.4 培养基

液体、半固体或固体形式的,含天然或合成成分,用于保证微生物繁殖、鉴定或保持其活力的物质。

##### 2.5 液体培养基

由含有一种或多种成分的水溶液组成的培养基(如:缓冲蛋白胨水)。

##### 2.6 固体培养基

在液体培养基中加入一定量固化物(如:琼脂),经煮沸或湿热灭菌处理,冷却至室温后凝固成固体状态的培养基。

倾注到平皿内的固体培养基一般称作“平板”;倒入试管并倾斜摆放的固体培养基,当培养基凝固后通常称作“斜面”。

##### 2.7 半固体培养基

在液体培养基中加入少量固化物(如:琼脂),经煮沸或湿热灭菌处理,冷却后成半固体状态的培养基。

##### 2.8 运输培养基

在取样后至实验室处理前,保护和维持微生物活性,且不允许微生物明显增殖或减少的培养基。  
运输培养基中通常不含使微生物增殖的物质,但是培养基应能保护菌株(如:缓冲甘油-氯化钠溶液

运输培养基)。

## 2.9 保藏培养基

用于在一定期限内保护和维持微生物活力,防止长期保存对其不利的影响,或使其在长期保存后容易复苏的培养基(如:营养琼脂斜面)。

## 2.10 悬浮培养基

将测试样品的微生物分散到液相中,在整个接触过程中不产生增殖或抑制作用的培养基(如:磷酸盐缓冲液)。

## 2.11 复苏培养基

能够使受损或应激的微生物修复,使微生物恢复正常生长能力,但不一定促进微生物繁殖的培养基(如:胰蛋白胨大豆肉汤)。

## 2.12 增菌培养基

通常为液体培养基,能够给微生物繁殖提供特定的生长环境。

## 2.13 选择性增菌培养基

能够允许特定的微生物在其中繁殖,而部分或全部抑制其他微生物生长的培养基(如:TTB培养基)。

## 2.14 非选择性增菌培养基

能够保证多种微生物生长的培养基(如:营养肉汤)。

## 2.15 分离培养基

支持微生物生长的固体或半固体培养基。

## 2.16 选择性分离培养基

支持特定微生物生长而抑制其他微生物生长的固体培养基(如:XLD琼脂)。

## 2.17 非选择性分离培养基

对微生物没有选择性抑制的固体培养基(如:营养琼脂)。

## 2.18 鉴别培养基(特异性培养基)

能够进行一项或多项微生物生理和(或)生化特性鉴定的培养基(如:伊红美蓝琼脂)。

注:能够用于分离培养的鉴别培养基被称作分离(鉴别)培养基(如:XLD琼脂)。

## 2.19 鉴定培养基

能够产生一个或多个特定的鉴定反应而通常不需要进一步确证试验的培养基(如:乳糖发酵管)。

注:用于分离的鉴定培养基被称为分离(鉴定)培养基。

## 2.20 计数培养基

能够对微生物进行定量计数的选择性(如:MYP琼脂)或非选择性培养基(如:平板计数琼脂)。

注:计数培养基可包含复苏和(或)增菌培养基的特性。

## 2.21 参比培养基

依据培养基配方特别制备,质量优良的培养基,用于培养基的质量控制,以保证食品微生物检验用培养基的质量。

参比培养基需由具备相应检验能力,并取得通过国家认证认可资质检验机构出具的检测报告。

## 2.22 商品化即用型培养基

以即用形式或熔化后即型形式置于容器(如:平皿、试管或其他容器)或载体内供应的液体、固体或半固体培养基:

- 完全可即用的培养基(如:测试片等);
- 需重新熔化的培养基(如:用于平板倾注技术);
- 使用前需重新熔化、分装(如:倾注到平皿)的培养基(如:制剂培养基);
- 使用前需重新熔化,添加物质并分装的培养基(如:TSC培养基和 Baird Parker 琼脂)。

注:测试片的测试方法及评定标准参照附录F,无法参照附录F部分(如菌落形态)可参考生产企业提供的操作说明来执行。

## 2.23 商品化脱水合成培养基

使用前需加水和进行处理的干燥培养基(如粉末、小颗粒、冻干等形式):

- 完全培养基,使用的时候无须加入其他成分;
- 不完全培养基,使用的时候需加入添加剂。

## 2.24 自制培养基

依据培养基完整配方的具体成分,实验室自行制备的培养基。

## 2.25 试剂

用于食品微生物检验的试剂和培养基配制的配套试剂。

## 2.26 测试菌株

通常用于培养基性能测试的微生物。

注:测试菌株根据其来源不同(见2.27~2.30)可进一步定义。

## 2.27 标准菌株

直接从专业菌种保藏机构获得并至少定义到属或种水平的菌株。按菌株特性进行分类和描述,最好来源于食品、水或其生产环境中的菌株。

## 2.28 标准储备菌株

将标准菌株在实验室转接一代后得到的一套完全相同的独立菌株。

## 2.29 储备菌株

从标准储备菌株转接一代获得的独立菌株。

## 2.30 工作菌株

由标准物质/标准样品或标准储备菌株、储备菌株转接一代获得的直接用于测试使用的菌株。

注:标准物质/标准样品是指含有一定数量活菌,符合预期用途并足够均匀和稳定的材料。

### 3 培养基及试剂质量保证

#### 3.1 证明文件

##### 3.1.1 生产企业提供的文件

生产企业应提供以下资料(可提供电子文本):

- 培养基或试剂的各种成分、添加成分名称及产品编号;
- 批号;
- pH(适用于培养基);
- 贮存信息和有效期;
- 标准要求及质控报告;
- 必要的安全和(或)危害数据。

##### 3.1.2 产品的交货验收

对每批产品,应记录接收日期,并检查:

- 产品合格证明材料;
- 包装的完整性;
- 产品的有效期;
- 其他必要的文件材料。

#### 3.2 贮存

##### 3.2.1 一般要求

应严格按照供应商提供的贮存条件、有效期和使用方法进行培养基和试剂的保存和使用。

##### 3.2.2 商品化脱水合成培养基及其添加成分

验收应包括以下内容:

- 容器密闭性检查;
- 内容物的感官检查。

开封后的脱水合成培养基,其质量取决于贮存条件。通过观察粉末或颗粒的流动性、均匀性、结块情况和色泽变化等,判断脱水培养基的质量变化。若发现培养基受潮或物理性状发生明显改变,则不应再使用。

##### 3.2.3 商品化即用型培养基和试剂

应严格按照供应商提供的贮存条件、有效期和使用方法进行保存和使用。

##### 3.2.4 实验室自制培养基

在保证其成分不会改变条件下保存,即避光、干燥保存,必要时在 2℃~8℃冰箱中保存,通常建议平板保存期不超过 4 周,瓶装及试管装培养基保存期不超过 6 个月。

如需在培养基中添加不稳定的添加剂,应即配即用;含有活性化学物质或不稳定性成分的固体培养基也应即配即用,不可二次熔化。

培养基的贮存应建立经验证的有效期。观察培养基是否有颜色变化、蒸发(脱水)或微生物生长的情况,当培养基发生这类变化时,应禁止使用。

培养基使用或再次加热前,应先取出平衡至室温。

### 3.3 培养基的实验室制备

#### 3.3.1 一般要求

正确制备培养基是微生物检验的最基础步骤之一,使用脱水培养基和其他成分,尤其是含有有毒有害物质(如胆盐或其他选择剂)的成分时,应遵守良好实验室规范和生产厂商提供的使用说明。培养基的不正确制备会导致培养基出现质量问题(见附录 B)。

使用商品化脱水合成培养基制备培养基时,应严格按照厂商提供的使用说明配制,如质量(体积)、pH、制备日期、灭菌条件和操作步骤等。

实验室使用各种基础成分制备培养基时,应按照配方准确配制,并记录相关信息,如培养基名称和类型及试剂级别、每个成分物质含量、制造商、批号、pH、培养基体积(分装体积)、无菌措施(包括实施的方式、温度及时间)、配制日期、人员等,以便溯源。

#### 3.3.2 水

试验用水的电导率在 25 °C 时不应超过 25  $\mu\text{S}/\text{cm}$ (相当于电阻率 $\geq 0.04 \text{ M}\Omega/\text{cm}$ ),除非另有规定要求。

试验用水的微生物污染不应超过  $10^3 \text{ CFU}/\text{mL}$ 。应按 GB 4789.2 定期检验微生物污染水平。

#### 3.3.3 称重和溶解

准确称量所需量的脱水合成培养基(必要时佩戴口罩或在通风柜或抽气罩下操作,以防吸入培养基粉末等有害物质),先加入适量的水,充分混合(注意避免培养基结块),然后加水至所需的量后适当加热,并重复或连续搅拌使其快速分散,含琼脂的培养基在加热溶解前应浸泡 3 min~5 min。

#### 3.3.4 pH 的测定和调节

除特殊说明外,灭菌后 pH 应在标准 pH $\pm 0.2$  范围内。一般使用浓度约为 1 mol/L 的氢氧化钠溶液或盐酸溶液调节培养基的 pH。

#### 3.3.5 分装

将配好的培养基分装至适当容器中,培养基体积不应超过容器容积的 2/3。

#### 3.3.6 灭菌/除菌

##### 3.3.6.1 一般要求

培养基应采用湿热灭菌法(见 3.3.6.2)或过滤除菌法(见 3.3.6.3)。

某些培养基如不适用湿热灭菌或过滤除菌的方式,则可使用煮沸杀菌方式处理。

##### 3.3.6.2 湿热灭菌

具体培养基应按食品微生物学检验标准中的规定或者商品使用说明进行灭菌。

如培养基体积超过 1 000 mL,应使用生物指示剂或相应设备进行灭菌效果验证。所有的操作应依照标准或使用说明的规定进行。

加热后采用适当的方式冷却,以防加热过度。这对于大容量和敏感培养基十分重要,例如含有煌绿的培养基。

### 3.3.6.3 过滤除菌

过滤除菌可使用孔径为  $0.22\ \mu\text{m}$  的无菌设备和滤膜过滤去除微生物。

## 3.4 培养基的使用

### 3.4.1 琼脂培养基的熔化

将培养基放入沸水浴中或采用有相同效果的方法(如高压锅中的层流蒸汽)使之熔化。经过高压的培养基应尽量减少重新加热时间。熔化后的培养基放入  $47\ ^\circ\text{C}\sim 50\ ^\circ\text{C}$  的恒温装置中冷却保温(可根据实际培养基凝固温度适当提高恒温装置温度),直至使用,培养基达到  $47\ ^\circ\text{C}\sim 50\ ^\circ\text{C}$  的时间与培养基的品种、体积和数量有关。熔化后的培养基应尽快使用,放置时间不应超过 4 h。未用完的培养基不能重新凝固留待下次使用。

### 3.4.2 培养基的脱氧

将培养基在使用前放到沸水浴或蒸汽浴中加热 15 min;加热时松开容器的盖子,加热后盖紧,并迅速冷却至使用温度(如液体硫乙醇酸盐培养基)。

### 3.4.3 添加成分的加入

待培养基冷却至  $47\ ^\circ\text{C}\sim 50\ ^\circ\text{C}$  时,加入平衡至室温的热不稳定添加成分,避免造成琼脂凝结或形成片状物。将加入添加成分的培养基缓慢充分混匀,尽快分装至待用的容器中。

### 3.4.4 平板的制备和贮存

倾注熔化的培养基至平皿中(直径 90 mm 的平皿,通常要加入 15 mL  $\sim$  20 mL 琼脂培养基),使之在平皿中的厚度至少为 3 mm。将平皿盖好皿盖后放在水平平面,使琼脂冷却凝固。如果平板需贮存,或者培养时间超过 48 h 或培养温度高于  $40\ ^\circ\text{C}$ ,则需要倾注更多的培养基。凝固后的培养基应立即使用或存放于暗处和(或)  $2\ ^\circ\text{C}\sim 8\ ^\circ\text{C}$  冰箱的密封袋中,以防止培养基成分的改变。在平板底部或侧边做好标记,标记的内容包括名称、制备日期和(或)有效期。也可使用适宜的培养基编码系统进行标记。

对于采用表面接种形式培养的固体培养基,应在生物安全柜或洁净工作台先对琼脂表面进行干燥。注意不要过度干燥。商品化的平板琼脂培养基应按照厂商提供的说明使用。

## 3.5 培养基的弃置

所有污染和未使用的培养基弃置应采用安全的方式,并且要符合相关法律法规的规定。

## 4 测试菌株的保藏及使用

### 4.1 一般要求

为成功保藏及使用菌株,不同菌株应采用不同的保藏方法,可选择使用冻干保藏、超低温(不高于  $-70\ ^\circ\text{C}$ )冷冻保藏、液氮保藏或其他有效的保藏方法。

### 4.2 商业来源的测试菌株

对于从标准菌种保藏中心或其他有效认证的商业机构获得的原包装测试菌株,复苏和使用应按照

制造商提供的使用说明进行。

### 4.3 实验室制备的标准储备菌株

用于性能测试的标准储备菌株(见附录 C 中图 C.1),在保存和使用时应注意避免交叉污染,减少菌株突变或发生典型的特性变化;标准储备菌株应制备多份,并采用超低温(不高于 $-70^{\circ}\text{C}$ )或冻干的形式保存。在较高温度下贮存时间应缩短。

标准储备菌株用作培养基的测试菌株时应在文件中充分描述其生长特性。

标准储备菌株不能用于制备标准菌株。

### 4.4 储备菌株

储备菌株通常用冻干或超低温保存的标准储备菌株进行制备(见图 C.2)。

制备储备菌株应避免标准储备菌株的交叉污染和(或)退化。制备储备菌株时,应将标准储备菌株制成菌悬液转接至非选择培养基中培养,以获得特性稳定的菌株。

对于商业来源的菌株,应严格按照制造商的说明执行。

储备菌株不能用于制备标准储备菌株或标准菌株。

### 4.5 工作菌株

工作菌株由标准储备菌株或储备菌株制备。

工作菌株不能用于制作标准菌株、标准储备菌株或储备菌株。

## 5 培养基和试剂的质量要求

### 5.1 基本要求

#### 5.1.1 培养基和试剂

培养基和试剂的质量由基础成分的质量、制备过程的控制、微生物污染的消除及包装和贮存条件等因素所决定。

供应商或制备者应对基础成分的质量、制备过程、微生物污染的消除及包装和贮存条件进行控制,确保培养基和试剂的理化特性满足相关标准的要求。

培养基和试剂的各种成分、添加剂或选择剂应进行适当的质量评价。

附录 F 中未描述的培养基和试剂,应根据以下规定进行质量控制:

- 不含指示剂或选择剂的培养基,可根据培养基的使用范围选择菌株进行测试;
- 含有指示剂和选择剂的培养基,应使用能证明指示剂和选择性功能的菌株进行测试;
- 使用前需添加添加剂的培养基和鉴定试剂,应使用特征性的菌株进行测试。

#### 5.1.2 基础成分

国家标准中列出的培养基成分通常可以直接使用。因用于制备培养基的部分成分(见附录 D)质量差异,可允许对其用量进行适当的调整,如:

- 根据营养需要改变胨类、浸粉类的用量;
- 根据所需凝胶作用的效果改变琼脂的用量;
- 根据缓冲要求决定缓冲物质用量;
- 根据选择性要求决定胆盐、胆汁抽提物和脱氧胆酸盐、抗菌染料的用量;
- 根据抗生素的效价决定其用量。

## 5.2 微生物学要求

### 5.2.1 概论

培养基和试剂应达到附录 F 质量控制标准的要求,其性能测试方法按第 6 章执行。实验室使用商品化培养基和试剂时,应保留生产商按 3.1.1 提供的资料,并制定验收程序。如果生产商能提供具备相应检验能力,并取得国家相关认证认可资质检验机构出具的同批次产品检验报告,实验室可保留相关证明文件,根据实际需求对该批次培养基的性能进行重复测试(附录 F 中未包含的培养基和试剂,可根据培养基和试剂的性能,参考附录 F 建立方法进行检验)。

### 5.2.2 生长特性

#### 5.2.2.1 一般要求

选择下列方法对每批成品培养基或试剂进行评价:

- 定量方法;
- 半定量方法;
- 定性方法。

采用定量方法时,应使用参比培养基(见附录 E)作为对照;采用半定量和定性方法时,使用能得到“阳性”结果的培养基作为对照有助于结果的解释。

#### 5.2.2.2 生长率

按规定用适当方法将适量测试菌株的工作菌悬液接种至固体、半固体和液体培养基中。

每种培养基上菌株的生长率应达到所规定的最低限值(见附录 F)。

#### 5.2.2.3 选择性

为定量评估培养基的选择性,应按照规定以适当方法将适量测试菌株的工作培养物接种至选择性培养基和参比培养基中,培养基的选择性应达到规定值(见附录 F)。

#### 5.2.2.4 生理生化特性(特异性)

确定培养基的菌落形态特征、鉴别特性,或试剂的鉴别特性,以获得培养基或试剂的基本特性(见附录 F)。

#### 5.2.2.5 性能评价和结果解释

若使用规定的所有测试菌株,培养基或试剂的性能测试达到标准要求,则该批培养基或试剂的性能测试结果符合规定。若基本要求和微生物学要求均符合规定,则该批培养基或试剂可被接受。

## 6 培养基和试剂性能测试方法

### 6.1 非选择性分离和计数固体培养基目标菌生长率定量测试方法

#### 6.1.1 工作菌悬液的制备

将标准储备菌株、储备菌株或工作菌株接种到非选择性肉汤培养过夜或采用其他方法,制备 10 倍系列稀释的菌悬液。进行生长率测试时,细菌和酵母菌每平板的接种水平为 50 CFU~250 CFU,霉菌每平板的接种水平为 30 CFU~150 CFU。

### 6.1.2 接种

选择适宜稀释度的工作菌悬液 0.1 mL,均匀涂布接种于待测平板和参比平板。每一稀释度接种两个平板。也可使用螺旋涂布法或倾注法进行接种,并按标准规定的条件培养。

### 6.1.3 计算

参考 GB 4789.2 的要求,选择菌落数适中的平板进行计数,生长率按式(1)计算。

$$P_R = \frac{N_S}{N_O} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

$P_R$ ——生长率;

$N_S$ ——待测培养基平板上的菌落总数平均值;

$N_O$ ——参比培养基平板上的菌落总数平均值。

### 6.1.4 结果解释

非选择性分离和计数固体培养基上目标菌的生长率应不小于 0.7。

## 6.2 选择性分离和计数固体培养基测试方法

### 6.2.1 目标菌生长率定量测试方法

#### 6.2.1.1 工作菌悬液的制备

按照 6.1.1 中要求进行。

#### 6.2.1.2 接种

按照 6.1.2 中要求进行。

#### 6.2.1.3 计算

按照 6.1.3 中要求进行。

#### 6.2.1.4 结果解释

目标菌在培养基上应呈现典型的生长。选择性分离固体培养基上目标菌的生长率一般应不小于 0.5,最低应为 0.1;选择性计数固体培养基上目标菌的生长率一般应不小于 0.7。具体要求参照附录 F 培养基质量控制标准。

### 6.2.2 非目标菌(选择性)半定量测试方法

#### 6.2.2.1 工作菌悬液的制备

将标准储备菌株、储备菌株或工作菌株接种到非选择性肉汤,培养过夜作为工作菌悬液。

#### 6.2.2.2 接种

用 1  $\mu$ L 接种环取选择性测试工作菌悬液 1 环,在待测培养基表面划六条平行直线(见图 1),同时接种两个平板,划线时可在培养基下面放一个模板图,按标准规定的条件培养。

取一满环接种物,将接种环接触容器边缘 3 次可去除多余的液体。划线时,接种环与琼脂平面的角

度应为  $20^{\circ}\sim 30^{\circ}$ 。接种环压在琼脂表面的压力和划线速度前后一致,整个划线应快速连续,移取液体培养物时应将接种环伸入培养液下部分以防止环上产生气泡或泡沫。

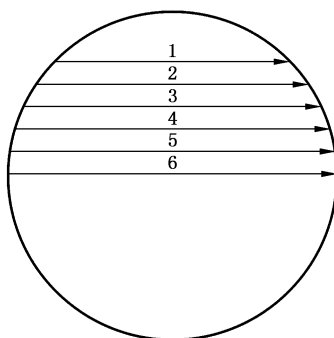


图 1 非目标菌半定量划线法接种模式图

#### 6.2.2.3 计算

培养后按以下方法对培养基计算生长指数  $G$ 。每条有比较稠密菌落连续生长的划线计为 1 分,每个培养皿上最多为 6 分。如果仅一半的线有稠密菌落生长,则计为 0.5 分。如果划线上没有菌落生长、生长量少于划线的一半或菌落生长微弱,则计为 0 分。记录每个平板的得分总和便得到  $G$ 。

#### 6.2.2.4 结果解释

非目标菌的生长指数  $G$  一般小于或等于 1,至少应小于 5。

### 6.2.3 非目标菌(特异性)定性测试方法

#### 6.2.3.1 工作菌悬液的制备

按照 6.2.2.1 中要求进行。

#### 6.2.3.2 接种

用  $1\ \mu\text{L}$  接种环取测试菌培养物在测试培养基表面进行分区划线。并按标准规定的培养条件培养平板。

#### 6.2.3.3 结果解释

非目标菌不生长或微弱生长。

### 6.3 非选择性增菌培养基半定量测试方法

#### 6.3.1 培养基的制备

将培养基分装试管,每管 10 mL。

#### 6.3.2 工作菌悬液的制备

将标准储备菌株、储备菌株或工作菌株接种到非选择性肉汤培养过夜或采用其他制备方法,制备 10 倍系列稀释的菌悬液。

### 6.3.3 接种

在装有待测培养基的试管中接种 10 CFU~100 CFU 的目标菌,接种体积不超过 1 mL,接种两个平行管。同时将 1 mL 菌悬液(与试管接种同一稀释度)倾注平板(或适宜稀释度 0.1 mL 涂布平板),接种两个平板,作接种量计数用。按标准方法中规定的培养时间和温度进行培养(如增菌时间为 8 h 以下,需取 10  $\mu$ L 培养后的增菌液倾注适合的培养基中,再按适合的培养时间和温度进行培养)。

### 6.3.4 结果解释

用目测的浊度值(如 0~2)评估培养基:

- 0 表示无浑浊;
- 1 表示轻微的浑浊;
- 2 表示明显的浑浊。

目标菌的浊度值应为 2。

有时可以观察到微生物生长后聚集成细胞团,沉积在试管或瓶子底部,发生这种情况时,小心振荡试管后再进行观察。

如增菌 8 h 以下,10  $\mu$ L 增菌液培养计数结果参照附录 F 培养基质量控制标准进行判定。

## 6.4 选择性增菌培养基半定量测试方法

### 6.4.1 培养基的制备

将培养基分装试管,每管 10 mL。

### 6.4.2 工作菌悬液的制备

按照 6.1.1 中要求进行。

### 6.4.3 接种

#### 6.4.3.1 目标菌的接种

在装有待测培养基的试管中接种 10 CFU~100 CFU 的目标菌(特殊接菌量参照附录 F 培养基质量控制标准),接种体积不超过 1 mL,同时接种两个平行管,混匀。将相同体积的目标菌菌悬液(与试管接种同一稀释度)倾注平板(或适宜稀释度 0.1 mL 涂布平板),接种两个平板,作接种量计数用。按标准方法中规定的培养时间和温度进行培养。

#### 6.4.3.2 非目标菌的接种

在装有待测培养基的试管中接种 1 000 CFU~5 000 CFU 的非目标菌,接种体积不超过 1 mL,同时接种两个平行管,混匀。同时将 1 mL 菌悬液(比待测培养基试管接种小 10 倍~100 倍稀释度)倾注平板(或适宜稀释度 0.1 mL 涂布平板),接种两个平板,作接种量计数用。按标准方法中规定的培养时间和温度进行培养。

### 6.4.4 培养液的接种

#### 6.4.4.1 目标菌培养液的接种

吸取 10  $\mu$ L 经培养后的目标菌培养液,均匀涂布或螺旋涂布接种到特定的选择性平板上(见 F.4)。按标准方法中规定的培养时间和温度进行培养。

#### 6.4.4.2 非目标菌培养液的接种

吸取 10  $\mu$ L 经培养后的非目标菌培养液,均匀涂布或螺旋涂布接种到非选择性平板(如 TSA)上。并按标准规定的培养条件培养平板。

#### 6.4.5 计算和结果解释

目标菌在选择性平板上的菌落应 $>10$  CFU,则表示待测液体培养基的生长率良好;非目标菌在非选择性平板上的菌落数应 $<100$  CFU,则表示待测液体培养基的选择性为良好。

### 6.5 选择性液体计数培养基半定量测试方法

#### 6.5.1 培养基的制备

将培养基分装试管,每管 10 mL。

#### 6.5.2 工作菌悬液的制备

按照 6.3.2 中要求进行。

#### 6.5.3 接种

##### 6.5.3.1 目标菌的接种

在装有待测培养基的试管中接种 10 CFU~100 CFU 的目标菌,接种体积不超过 1 mL,同时接种两个平行管,混匀。将相同体积的目标菌菌悬液(与试管接种同一稀释度)倾注平板(或适宜稀释度 0.1 mL 涂布平板),接种两个平板,作接种量计数用。按标准方法中规定的培养时间和温度进行培养。

##### 6.5.3.2 非目标菌的接种

在装有待测培养基的试管中接种 1 000 CFU~5 000 CFU 的非目标菌,接种体积不超过 1 mL,同时接种两个平行管,混匀。同时将 1 mL 菌悬液(比试管接种小 10 倍~100 倍稀释度)倾注平板(或适宜稀释度 0.1 mL 涂布平板),接种两个平板,作接种量计数用。按标准方法中规定的培养时间和温度进行培养。

#### 6.5.4 结果解释

用目测的浊度值(如 0~2)评估培养基:

——0 表示无浑浊;

——1 表示轻微的浑浊;

——2 表示明显的浑浊。

并记录小导管收集气体的体积比。

注:有时可以观察到微生物生长后聚集成细胞团,沉积在试管或瓶子底部,发生这种情况时,小心振荡试管,混匀后再进行观察。

### 6.6 悬浮培养基和运输培养基定量测试方法

#### 6.6.1 培养基的制备

将培养基分装试管,每管 10 mL(有特殊要求的可选用 5 mL)。

### 6.6.2 目标菌工作菌悬液的制备

按照 6.3.2 中要求进行。

### 6.6.3 接种

在装有待测培养基的试管中接种 100 CFU~1 000 CFU 的目标菌,同时接种两个平行管,混匀后,立即吸取 1 mL 待测培养基混合液,参照附录 F 培养基质量控制标准选用相应的培养基倾注平板,每管待测培养基接种一个平板。按标准方法中规定的培养时间和温度培养后,进行菌落计数。

剩余已接种菌液的待测培养基 20℃~25℃下放置 45 min 后,再吸取 1 mL 倾注平板,每管培养基接种一个平板,按标准方法中规定的培养时间和温度培养后,进行菌落计数。如保存条件有特殊要求的待测培养基,参照附录 F 培养基质量控制标准要求放置或培养后再进行菌落计数。

### 6.6.4 结果观察与解释

待测培养基中的菌落数变化应在±50%内。

## 6.7 鉴定培养基测试方法

### 6.7.1 液体培养基

#### 6.7.1.1 培养基的制备

将培养基分装试管,再进行灭菌和添加试剂。

#### 6.7.1.2 工作菌悬液的制备

将标准储备菌株、储备菌株或工作菌株接种到非选择性平板上或采用其他制备方法,制备成约  $10^9$  CFU/mL 的菌悬液。

#### 6.7.1.3 接种

吸取 0.05 mL 至待测培养基内,按标准方法中规定的培养时间和温度进行培养。

#### 6.7.1.4 结果观察与解释

需加指示剂的试验在微生物生长良好的情况下,按顺序加入指示剂,再观察结果。结果解释参照表 F.7。

### 6.7.2 半固体培养基

#### 6.7.2.1 培养基的制备

将培养基分装试管。灭菌后竖立放置,冷却后备用。

#### 6.7.2.2 接种

取新鲜测试菌株,用接种针挑取菌苔穿刺接种至待测培养基内。按标准方法中规定的培养时间和温度进行培养。

#### 6.7.2.3 结果观察与解释

需加指示剂的试验在微生物生长良好的情况下,按顺序加入指示剂,再观察结果。结果解释参照

表 F.7。

### 6.7.3 高层斜面培养基和斜面培养基

#### 6.7.3.1 培养基的制备

将培养基分装试管。灭菌后摆放成高层斜面(斜面与底层高度之比约为 2 : 3)和普通斜面(斜面与底层高度之比约为 3 : 2),冷却后备用。

#### 6.7.3.2 接种

高层斜面培养基:取新鲜测试菌株斜面,用接种针挑取菌苔,根据培养基接种要求可选择先穿刺接种至琼脂高层,穿刺接种完毕后,再在斜面上划“之”字形划线接种,或先在斜面上划“之”字形划线接种再穿刺接种;斜面培养基:取新鲜测试菌株斜面,用接种环挑取菌苔,在斜面上划“之”字形划线接种。按标准方法中规定的培养时间和温度进行培养。

#### 6.7.3.3 结果观察与解释

需加指示剂的试验,在微生物生长良好的情况下,按顺序加入指示剂,再观察结果。结果解释参照表 F.7。

### 6.7.4 平板培养基

#### 6.7.4.1 培养基的制备

倾注灭菌熔化的培养基至平皿中,使之在平皿中形成至少 3 mm 厚的琼脂层(直径 90 mm 的平皿通常要加入 18 mL ~20 mL 琼脂培养基)。

#### 6.7.4.2 接种

取新鲜测试菌株,用接种环挑取菌苔,在平板上划“之”字形接种,或用接种针挑取菌苔,在平板上点种接种。按标准方法中规定的培养时间和温度进行培养。

#### 6.7.4.3 结果观察与解释

参照表 F.7。

### 6.8 实验试剂测试方法

#### 6.8.1 试验方法

按试剂说明书进行。

#### 6.8.2 结果观察与解释

参照表 F.7。

## 附录 A

### 培养基性能测试方法流程图

固体培养基目标菌生长率定量测试方法见图 A.1。

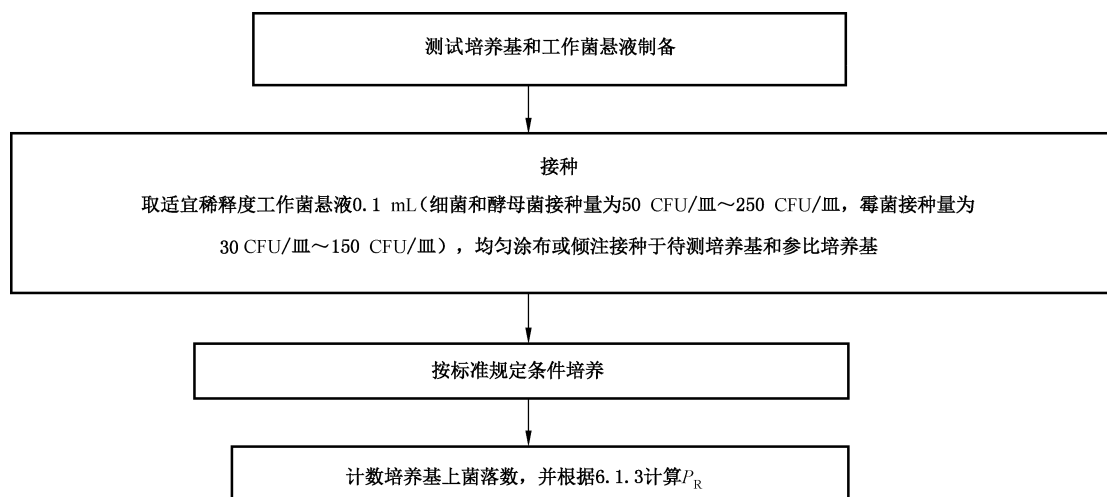


图 A.1 固体培养基目标菌生长率定量测试方法流程图

固体培养基非目标菌(选择性)半定量测试方法见图 A.2。

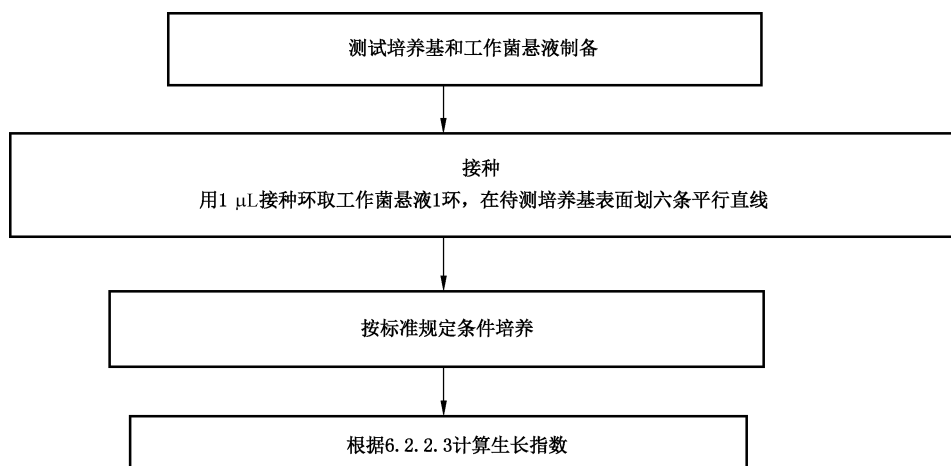


图 A.2 固体培养基非目标菌(选择性)半定量测试方法流程图

固体培养基非目标菌(特异性)定性测试方法见图 A.3。

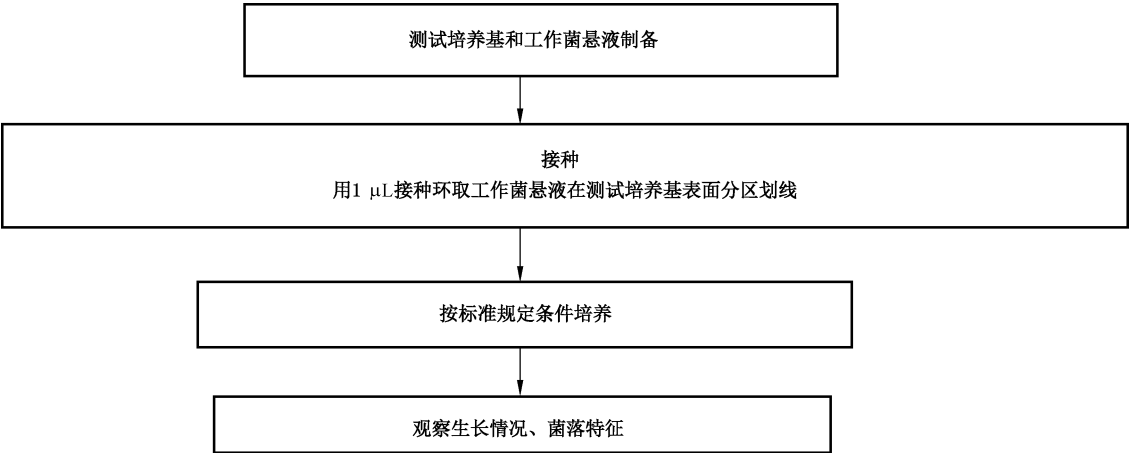


图 A.3 固体培养基非目标菌(特异性)定性测试方法流程图

非选择性增菌培养基半定量测试方法见图 A.4。

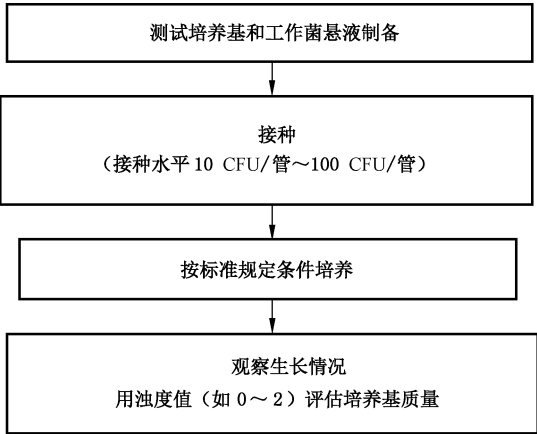


图 A.4 非选择性增菌培养基半定量测试方法流程图

选择性增菌培养基半定量测试方法见图 A.5。

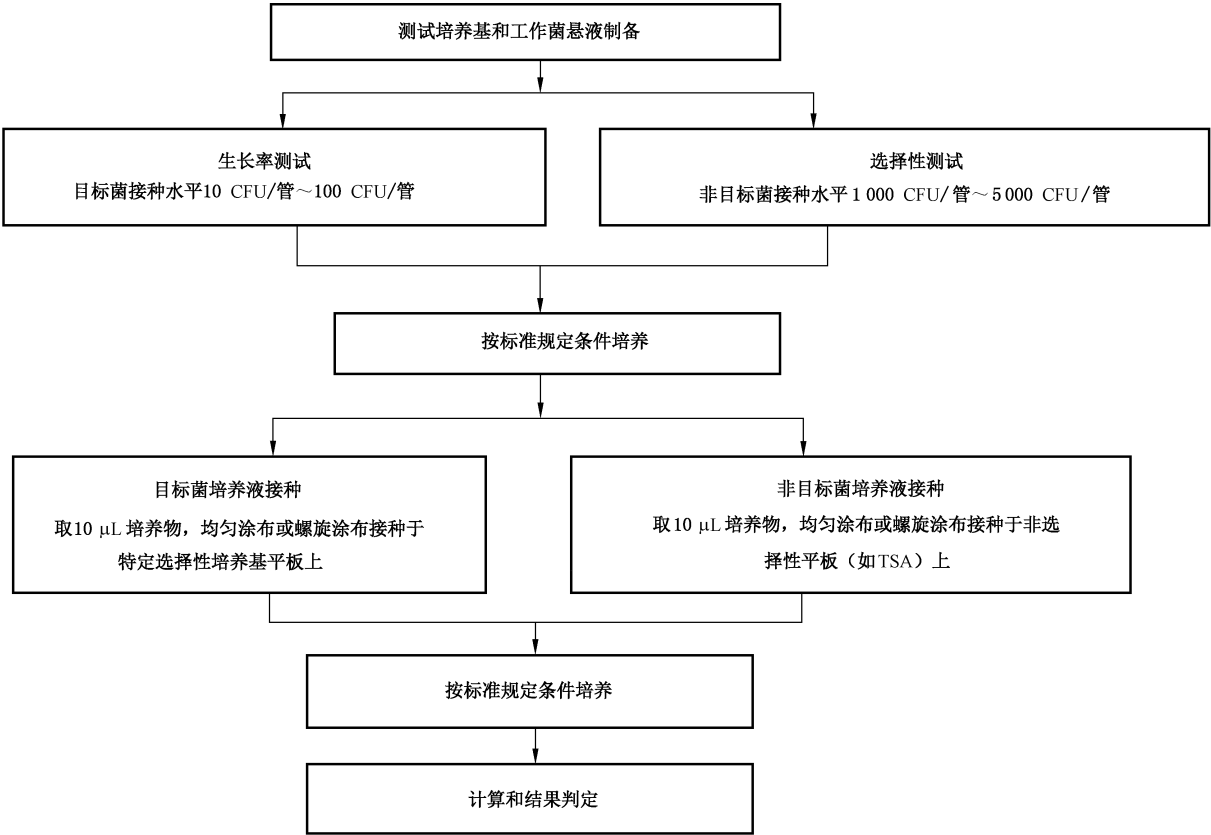


图 A.5 选择性增菌培养基半定量测试方法流程图

选择性液体计数培养基半定量测试方法见图 A.6。

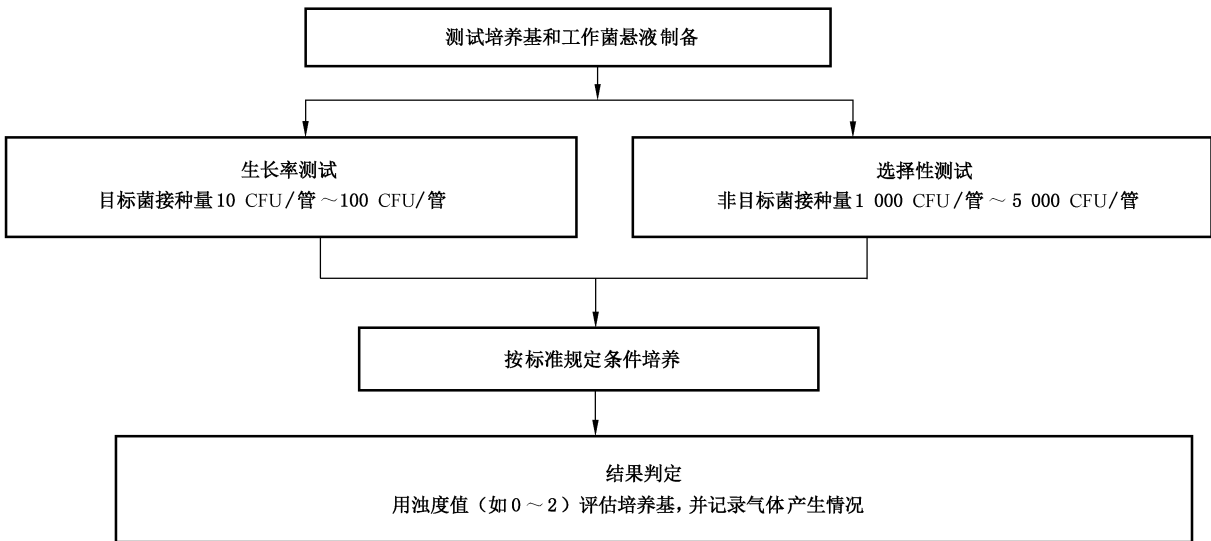


图 A.6 选择性液体计数培养基半定量测试方法流程图

悬浮培养基和运输培养基定量测试方法见图 A.7。

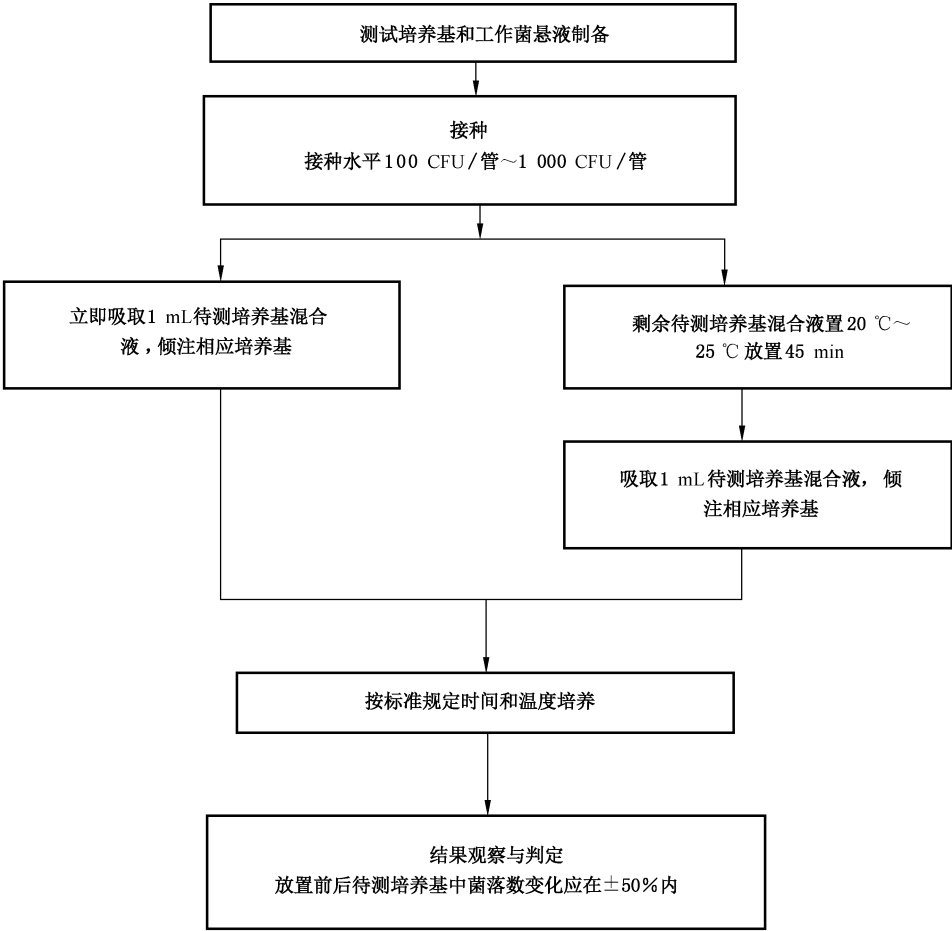


图 A.7 悬浮培养基和运输培养基定量测试方法流程图

附 录 B  
培养基不正确配制出现的质量问题及原因分析


培养基不正确配制出现的质量问题及原因分析见表 B.1。

表 B.1 常见质量问题与解答

| 异常现象         | 可能原因                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 培养基不能凝固      | 制备过程中过度加热<br>低 pH 造成培养基酸解<br>称量不正确<br>琼脂未完全溶解<br>培养基成分未充分混匀                 |
| pH 不正确       | 制备过程中过度加热<br>水质不佳<br>外部化学物质污染<br>测定 pH 时温度不正确<br>pH 计未正确校准<br>脱水培养基质量差      |
| 颜色异常         | 制备过程中过度加热<br>水质不佳<br>pH 不正确<br>外来污染<br>脱水培养基质量差                             |
| 产生沉淀         | 制备过程中过度加热<br>水质不佳<br>脱水培养基质量差<br>pH 未正确控制<br>原料中的杂质                         |
| 培养基出现抑制/低生长率 | 制备过程中过度加热<br>脱水培养基质量差<br>水质不佳<br>使用成分不正确,如,成分称量不准,添加剂浓度不正确<br>制备容器或水中有毒残留物  |
| 选择性差         | 制备过程中过度加热<br>脱水培养基质量差<br>配方使用不对<br>添加成分加入不正确,例如加入添加成分时培养基过热或添加浓度错误<br>添加剂污染 |
| 污染           | 不适当灭菌<br>无菌操作技术存在问题<br>添加剂污染                                                |

附 录 C  
标准储备菌株和工作菌株制备


标准菌株制备标准储备菌株流程见图 C.1。

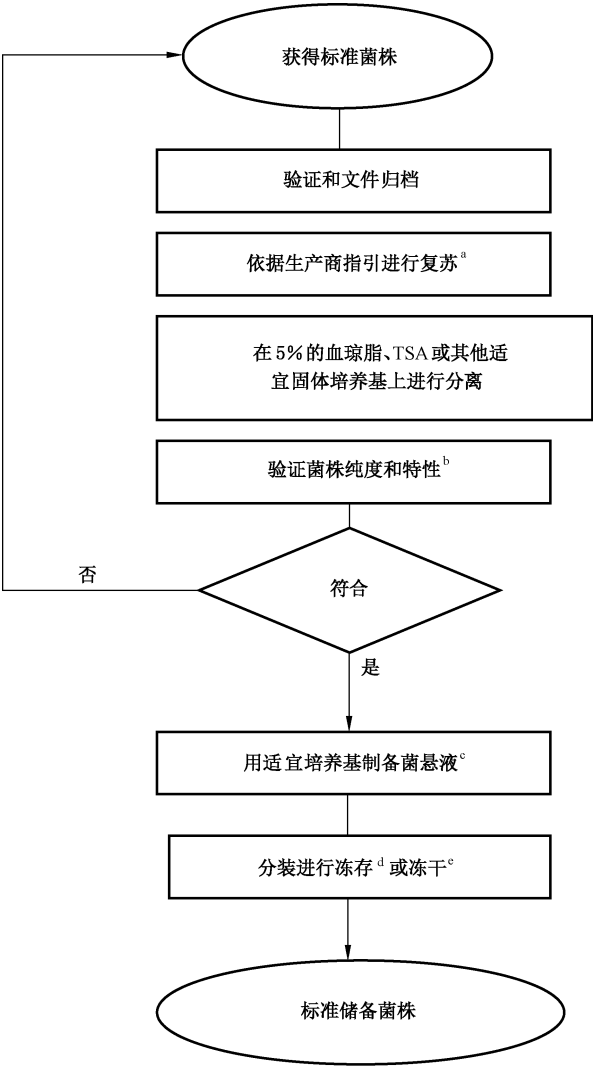

<sup>a</sup> 通常悬浮于营养肉汤中，培养适宜时间进行复苏。  
<sup>b</sup> 验证菌落形态和革兰氏染色，或用生化试验进行鉴定。  
<sup>c</sup> 例如，BHI 添加 40%~60% 甘油作为冷冻保护培养基。  
<sup>d</sup> 冻存管可含有多孔小珠子。  
<sup>e</sup> 在不高于 -70℃ 低温下冷冻保存可延长保存的时间，在较高温度下保存时间将缩短。

图 C.1 制作标准储备菌株的流程图

标准储备菌株制备工作菌株的流程见图 C.2。

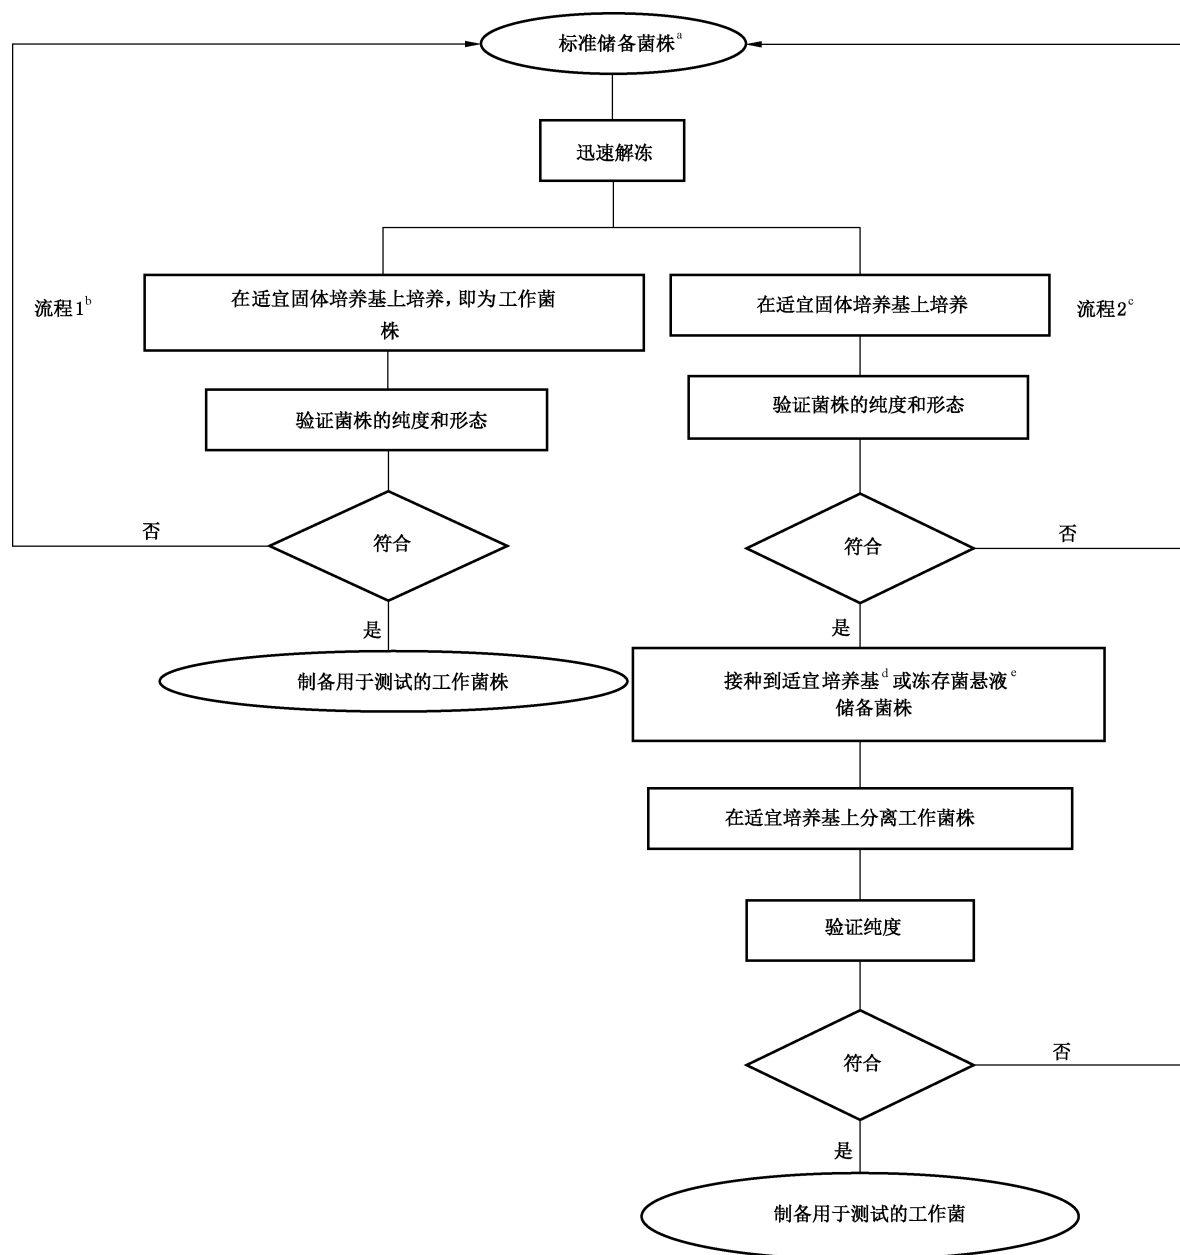

<sup>a</sup> 如果标准储备菌株来源于别处，应加以验证及归档，包括核查能否溯源至标准菌株及相关特性。

<sup>b</sup> 此流程适用于一般试验。

<sup>c</sup> 此流程对某些菌株是必需的，如定量试验。应对所有阶段资料进行归档。

<sup>d</sup> 例如，可接种到 TSA 斜面、TSA 血琼脂斜面或其他合适的培养基，培养 22 h~24 h，然后在适宜的温度（依据不同微生物在 18℃~25℃ 或 2℃~8℃）可存放 4 周。

<sup>e</sup> 例如，BHI 添加 40%~60% 甘油作为冷冻保护培养基。在不高于 -70℃ 低温冷冻保存可延长保存的时间，在较高温度下保存时间将缩短。

图 C.2 制作工作菌株的流程图

**附 录 D**  
**食品安全微生物检验标准中指定的培养基成分**

**D.1 胨类**

蛋白胨 Peptone:胃蛋白酶或胰酶消化动物组织水解物

胰蛋白胨 Tryptone(或胰酪胨 Casein tryptone、胰酶消化酪蛋白胨 Pancreatic digest of casein):酪蛋白胰酶水解物

胨蛋白胨 Proteose peptone:胰酶低程度消化酪蛋白水解物

多价蛋白胨 Polypeptone:酪蛋白胨和蛋白胨等的混合物

明胶蛋白胨 Gelatin peptone:胰酶消化明胶水解物

大豆蛋白胨 Soya peptone:木瓜蛋白酶消化大豆蛋白的水解物

酸水解酪蛋白 Casein acid hydrolysate:盐酸消化酪蛋白的水解物

**D.2 浸粉类**

大部分浸粉是将植物或动物组织切开研碎,去除杂质,洗干净后,加适量纯化水后放置 2℃~10℃浸泡,然后加热或煮沸适当时间,调节 pH,过滤,喷雾干燥而成。浸粉中富含生长促进因子、维生素或高碳水化合物,能促进微生物快速生长发育。而酵母浸粉是以高蛋白面包酵母或啤酒酵母为原料,经自溶、酶解、浓缩、干燥等工艺制成的一种富含蛋白质、氨基酸、肽、多肽、核酸、维生素及微量元素等的营养成分。

主要浸粉:

牛肉浸粉、牛心浸粉、牛脑浸粉、脑心浸粉、牛肝浸粉、酵母浸粉、马铃薯浸粉、麦芽浸粉、豌豆浸粉、玉米浸粉。

**D.3 胆盐及胆汁类**

牛胆盐、猪胆盐、3号胆盐、去氧胆酸钠、牛胆汁粉、猪胆汁粉。

**D.4 凝固剂类**

琼脂、明胶。

**D.5 其他**

亚碲酸盐卵黄乳液、卵黄乳液、脱脂奶粉、兔血浆、兔血球、脱纤维羊血。

附 录 E  
食品安全微生物检验标准中参比培养基的质控标准

食品安全微生物检验标准中参比培养基的质控标准如下,参比培养基具体检验方法可参考 6.1 或 6.2.3。

E.1 沙氏葡萄糖琼脂(Sabouraud Dextrose Agar Medium,SDA)参比培养基质控标准

E.1.1 成分

|      |        |
|------|--------|
| 蛋白胨  | 5.0 g  |
| 酪蛋白胨 | 5.0 g  |
| 葡萄糖  | 40.0 g |
| 琼脂   | 15.0 g |

E.1.2 原理

葡萄糖提供碳源;蛋白胨和胰蛋白胨提供氮源;琼脂是培养基的凝固剂。

E.1.3 制法

将上述成分加热溶解于 1 000 mL 蒸馏水中,121 ℃ 高压灭菌 15 min 备用。

E.1.4 质控标准

见表 E.1。

表 E.1 SDA 参比培养基质控标准

| 项目    | 质控指标                  | 质控条件                                  | 质控评定标准            |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 理化    | 外观                    | —                                     | 淡黄色粉末,灭菌后为淡黄色透明胶体 |
|       | pH                    | 121 ℃ 高压灭菌 15 min 后,倾<br>倒平板,待室温凝固后测定 | 5.6±0.2           |
| 促生长能力 | 测试菌株                  | 培养温度与培养时间                             | 菌落形态              |
|       | 黑曲霉<br>CMCC(F)98003   | 28 ℃ ±1 ℃,72 h~96 h                   | 生长良好,白色菌丝,黑色孢子    |
|       | 白色念珠菌<br>CMCC(F)98001 | 28 ℃ ±1 ℃,72 h~96 h                   | 生长良好,白色圆形菌落       |
|       | 酿酒酵母<br>CMCC(F)98018  | 28 ℃ ±1 ℃,72 h~96 h                   | 生长良好,奶油色圆形菌落      |
|       | 桔青霉<br>CMCC(F)98028   | 28 ℃ ±1 ℃,72 h~96 h                   | 生长良好,白色菌丝,绿色孢子    |
|       | 产黄青霉<br>CMCC(F)98801  | 28 ℃ ±1 ℃,72 h~96 h                   | 生长良好,白色菌丝,绿色孢子    |

E.2 MRS 琼脂(MRS Agar)参比培养基质控标准

E.2.1 成分

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| 蛋白胨                                                            | 10.0 g |
| 牛肉浸粉                                                           | 5.0 g  |
| 酵母浸粉                                                           | 4.0 g  |
| 葡萄糖                                                            | 20.0 g |
| 吐温 80                                                          | 1.0 mL |
| 七水合磷酸氢二钾( $\text{K}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ) | 2.0 g  |
| 三水合醋酸钠( $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ )  | 5.0 g  |
| 柠檬酸三铵 $[\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7(\text{NH}_4)_3]$        | 2.0 g  |
| 七水合硫酸镁( $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ )            | 0.2 g  |
| 四水合硫酸锰( $\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ )            | 0.05 g |
| 琼脂                                                             | 15.0 g |

E.2.2 原理

蛋白胨、牛肉浸粉、酵母浸粉提供氮源、维生素、生长因子；葡萄糖为可发酵糖类；七水合磷酸氢二钾为酸碱缓冲剂；柠檬酸三铵、七水合硫酸镁、四水合硫酸锰、吐温 80 和三水合醋酸钠为培养各种乳酸菌提供生长因子，其成分还能抑制某些杂菌；琼脂是培养基的凝固剂。

E.2.3 制法

加热溶解于 1 000 mL 蒸馏水中，121 ℃ 高压灭菌 15 min 备用。

E.2.4 质控标准

见表 E.2。

表 E.2 MRS 琼脂参比培养基质控标准

| 项目  | 质控指标                        | 质控条件                              | 质控评定标准                        |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 理化  | 外观                          | —                                 | 为淡黄色均匀粉末。加入水中混悬均匀，灭菌后为琥珀色透明胶体 |
|     | pH                          | 121 ℃ 高压灭菌 15 min 后，倾倒平板，待室温凝固后测定 | 6.2±0.2                       |
| 微生物 | 测试菌株                        | 培养温度与培养时间                         | 菌落形态                          |
|     | 德氏乳杆菌保加利亚亚种<br>CMCC(B)34131 | 36 ℃ ±1 ℃，72 h ±2 h，厌氧            | 生长良好，浅灰色，边缘不规则                |
|     | 嗜热链球菌<br>CMCC(B)32483       | 36 ℃ ±1 ℃，72 h ±2 h，厌氧            | 生长良好，白色圆形                     |
|     | 长双歧杆菌婴儿亚种 CMCC<br>(B)93905  | 36 ℃ ±1 ℃，72 h ±2 h，厌氧            | 生长良好，白色圆形                     |
|     | 瑞士乳杆菌<br>CICC 6032          | 36 ℃ ±1 ℃，72 h ±2 h，厌氧            | 生长良好，白色圆形                     |

表 E.2 MRS 琼脂参比培养基质控标准（续）

| 项目  | 质控指标                   | 质控条件                   | 质控评定标准     |
|-----|------------------------|------------------------|------------|
| 微生物 | 戊糖乳杆菌<br>CICC 22707    | 36 ℃±1 ℃, 72 h±2 h, 厌氧 | 生长良好, 白色圆形 |
|     | 植物乳杆菌<br>CMCC(B)34134  | 36 ℃±1 ℃, 72 h±2 h, 厌氧 | 生长良好, 白色圆形 |
|     | 干酪乳酪杆菌<br>CMCC(B)34135 | 36 ℃±1 ℃, 72 h±2 h, 厌氧 | 生长良好, 白色圆形 |

E.3 胰蛋白胨大豆琼脂(Trypticase Soy Agar, TSA)参比培养基质控标准

E.3.1 成分

|       |        |
|-------|--------|
| 胰蛋白胨  | 15.0 g |
| 大豆蛋白胨 | 5.0 g  |
| 氯化钠   | 5.0 g  |
| 琼脂    | 15.0 g |

E.3.2 原理

胰蛋白胨、大豆蛋白胨提供氮源、维生素和生长因子；氯化钠维持均衡的渗透压；琼脂是培养基的凝固剂。

E.3.3 制法

取上述成分，加热溶解于 1 000 mL 蒸馏水中，121 ℃ 高压灭菌 15 min 备用。TSA+5%裂解羊血为在 TSA 基础上添加 5%裂解羊血，3%氯化钠 TSA 为在 TSA 基础上添加 2.5%氯化钠。

E.3.4 质控标准

见表 E.3。

表 E.3 TSA 参比培养基质控标准

| 项目  | 质控指标                    | 质控条件                              | 质控评定标准                |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 理化  | 外观                      | —                                 | 为淡黄色粉末，灭菌后为淡黄色透明胶体    |
|     | pH                      | 121 ℃ 高压灭菌 15 min 后，倾倒平板，待室温凝固后测定 | 7.3±0.2               |
| 微生物 | 测试菌株 <sup>a</sup>       | 培养温度与培养时间                         | 菌落形态                  |
|     | 莫氏克罗诺杆菌<br>CMCC(B)45407 | 25 ℃±1 ℃, 48 h±2 h                | 生长良好，菌落黄色，圆形，表面光滑，湿润  |
|     | 大肠埃希氏菌<br>CMCC(B)44102  | 36 ℃±1 ℃, 24 h±2 h                | 生长良好，菌落灰白色，圆形，表面光滑，湿润 |
|     | 金黄色葡萄球菌<br>CMCC(B)26003 | 36 ℃±1 ℃, 24 h±2 h                | 生长良好，菌落淡黄色，圆形         |

表 E.3 TSA 参比培养基质控标准（续）

| 项目                              | 质控指标                       | 质控条件                | 质控评定标准                   |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 微生物                             | 枯草芽孢杆菌<br>CMCC(B)63501     | 36 ℃±1 ℃, 24 h±2 h  | 生长良好, 菌落灰白色, 圆形, 干燥      |
|                                 | 白色念珠菌<br>CMCC(F)98001      | 28 ℃±1 ℃, 72 h~96 h | 生长良好, 菌落白色, 圆形, 表面光滑, 湿润 |
|                                 | 黑曲霉<br>CMCC(F)98003        | 28 ℃±1 ℃, 72 h~96 h | 生长良好, 产黑色孢子              |
|                                 | 粪肠球菌<br>CMCC(B)32480       | 36 ℃±1 ℃, 24 h±2 h  | 生长良好, 菌落白色, 圆形           |
|                                 | 人参土芽孢杆菌<br>CMCC(B)63612    | 36 ℃±1 ℃, 48 h±2 h  | 生长良好, 菌落灰白色, 圆形          |
|                                 | 藤黄微球菌<br>CMCC(B)28001      | 36 ℃±1 ℃, 48 h±2 h  | 生长良好, 菌落浅黄色, 圆形          |
|                                 | 嗜热嗜脂肪地芽孢杆菌<br>CMCC(B)63509 | 56 ℃±1 ℃, 24 h±2 h  | 灰白色, 圆形, 表面光滑, 湿润        |
| <sup>a</sup> 参比培养基测试菌株一览表见表 E.4 |                            |                     |                          |

表 E.4 参比培养基测试菌株一览表

| 序号 <sup>a</sup> | 中文名           | 拉丁名                                                          | CMCC 编号 <sup>b</sup> | CICC 编号 <sup>c</sup> | GDMCC 编号 <sup>d</sup> |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1               | 白色念珠菌(白假丝酵母)  | <i>Candida albicans</i>                                      | CMCC(F)98001         | CICC 1965            | GDMCC 2,178           |
| 2               | 阪崎克罗诺杆菌       | <i>Cronobacter sakazakii</i>                                 | CMCC(B)45407         | CICC 25036           | GDMCC 1,296           |
| 3               | 产黄青霉          | <i>Penicillium chrysogenum</i>                               | CMCC(F)98801         | CICC 41780           | GDMCC 3,710           |
| 4               | 大肠埃希氏菌        | <i>Escherichia coli</i>                                      | CMCC(B)44102         | CICC 24106           | GDMCC 1,223           |
| 5               | 德氏乳杆菌保加利亚亚种   | <i>Lactobacillus delbrueckii</i><br>subsp. <i>bulgaricus</i> | CMCC(B)34131         | CICC 25031           | GDMCC 1,2783          |
| 6               | 粪肠球菌          | <i>Enterococcus faecalis</i>                                 | CMCC(B)32480         | CICC 25037           | GDMCC 1,2902          |
| 7               | 干酪乳酪杆菌        | <i>Lactocaseibacillus casei</i>                              | CMCC(B)34135         | CICC 25035           | GDMCC 1,2885          |
| 8               | 黑曲霉           | <i>Aspergillus niger</i>                                     | CMCC(F)98003         | CICC 2487            | GDMCC 3,516           |
| 9               | 金黄色葡萄球菌       | <i>Staphylococcus aureus</i>                                 | CMCC(B)26003         | CICC 10384           | GDMCC 1,221           |
| 10              | 桔青霉           | <i>Penicillium citrinum</i>                                  | CMCC(F)98028         | CICC 41779           | GDMCC 3,693           |
| 11              | 枯草芽孢杆菌        | <i>Bacillus subtilis</i>                                     | CMCC(B)63501         | CICC 10275           | GDMCC 1,222           |
| 12              | 酿酒酵母          | <i>Saccharomyces cerevisiae</i>                              | CMCC(F)98018         | CICC 33482           | GDMCC 2,243           |
| 13              | 人参土芽孢杆菌       | <i>Bacillus ginsengihumi</i>                                 | CMCC(B)63612         | CICC 25038           | GDMCC 1,2919          |
| 14              | 瑞士乳杆菌         | <i>Lactobacillus helveticus</i>                              | —                    | CICC 6032            | —                     |
| 15              | 嗜根考克氏菌(藤黄微球菌) | <i>Kocuria rhizophila</i> ( <i>Micrococcus luteus</i> )      | CMCC(B)28001         | CICC 10445           | GDMCC 1,226           |
| 16              | 嗜热链球菌         | <i>Streptococcus thermophilus</i>                            | CMCC(B)32483         | CICC 25032           | GDMCC 1,2800          |
| 17              | 嗜热脂肪地芽孢杆菌     | <i>Geobacillus stearothermophilus</i>                        | CMCC(B)63509         | CICC 25039           | GDMCC 1,301           |

表 E.4 参比培养基测试菌株一览表（续）

| 序号 <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                           | 中文名            | 拉丁名                                                                     | CMCC 编号 <sup>b</sup> | CICC 编号 <sup>c</sup> | GDMCC 编号 <sup>d</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 18                                                                                                                                                                                                        | 戊糖乳植物杆菌        | <i>Lactiplantibacillus pentosus</i>                                     | CMCC(B)34133         | CICC 22707           | GDMCC 1.2851          |
| 19                                                                                                                                                                                                        | 长双歧杆菌婴儿亚种      | <i>Bifidobacterium longum</i> subsp. <i>infantis</i>                    | CMCC(B)93905         | CICC 25033           | GDMCC 1.2817          |
| 20                                                                                                                                                                                                        | 植物乳杆菌(植物乳植物杆菌) | <i>Lactobacillus plantarum</i> ( <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ) | CMCC(B)34134         | CICC 25034           | GDMCC 1.2868          |
| <p><sup>a</sup> 为方便检验实验室菌种获取,同一序号菌种如出现不同菌种编号,全部为同一株菌在三家菌种保藏管理中心注册获得。</p> <p><sup>b</sup> CMCC 代表中国医学细菌保藏管理中心。</p> <p><sup>c</sup> CICC 代表中国工业微生物菌种保藏管理中心。</p> <p><sup>d</sup> GDMCC 代表广东省微生物菌种保藏管理中心。</p> |                |                                                                         |                      |                      |                       |

附录 F  
食品微生物实验室使用培养基和试剂的质量控制标准

食品微生物实验室使用培养基和试剂的质量控制标准见表 F.1～表 F.8。

表 F.1 非选择性分离和计数固体培养基质量控制标准

| 培养基                | 状态 | 功能分类   | 质控指标 | 培养条件                | 测试菌株*                               | 参比培养基        | 方法 | 质控评定标准 | 特征性反应                 |
|--------------------|----|--------|------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----|--------|-----------------------|
| 胰蛋白胨大豆琼脂           | 固体 | 非选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>24 h±2 h  | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922 | TSA          | 定量 | PR≥0.7 | —                     |
|                    |    |        |      |                     | 粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212   |              |    |        | —                     |
| MC 培养基             | 固体 | 非选择性计数 | 生长率  | 36℃±1℃<br>72 h±2 h  | 嗜热链球菌 CICC 6038                     | MRS          | 定量 | PR≥0.7 | 中等偏小,边缘光滑的红色菌落,可有淡淡的晕 |
| MRS 培养基            | 固体 | 非选择性计数 | 生长率  | 36℃±1℃<br>48 h~72 h | 瑞士乳杆菌 CICC 6032                     | MRS          | 定量 | PR≥0.7 | 圆形凸起,中等大小,边缘整齐,无色不透明  |
|                    |    |        |      |                     | 嗜热链球菌 CICC 6038                     |              |    |        | 圆形凸起,菌落偏小,边缘整齐,无色不透明  |
|                    |    |        |      |                     | 长双歧杆菌婴儿亚种,<br>CICC 6069(厌氧培养)       |              |    |        | 圆形,中等大小,边缘整齐,瓷白色      |
| 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂(TSA) | 固体 | 非选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>8 h~18 h  | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802  | 3%氯化钠<br>TSA | 定量 | PR≥0.7 | 无色半透明菌落               |
|                    |    |        |      |                     | 创伤弧菌 CMCC(B)17244<br>或 ATCC 27562   |              |    |        |                       |

表 F.1 非选择性分离和计数固体培养基质量控制标准 (续)

| 培养基                        | 状态 | 功能分类   | 质控指标 | 培养条件                       | 测试菌株*                                       | 参比培养基 | 方法 | 质控评定标准 | 特征性反应     |
|----------------------------|----|--------|------|----------------------------|---------------------------------------------|-------|----|--------|-----------|
| 营养琼脂                       | 固体 | 非选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>20 h~24 h        | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922         | TSA   | 定量 | PR≥0.7 | —         |
|                            |    |        |      |                            | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538         |       |    |        |           |
|                            |    |        |      |                            | 枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63542<br>或 ATCC 6633          |       |    |        |           |
| 含 0.6%酵母浸膏的胰酪陈大豆琼脂(TSA-YE) | 固体 | 非选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h~24 h        | 单核细胞增生李斯特氏菌<br>CMCC(B)54012<br>或 ATCC 19115 | TSA   | 定量 | PR≥0.7 | —         |
| 平板计数琼脂(PCA)                | 固体 | 非选择性计数 | 生长率  | 36℃±1℃<br>48 h±2 h         | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922         | TSA   | 定量 | PR≥0.7 | —         |
|                            |    |        |      |                            | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538         |       |    |        |           |
|                            |    |        |      |                            | 枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63542<br>或 ATCC 6633          |       |    |        |           |
| 双歧杆菌琼脂培养基                  | 固体 | 非选择性计数 | 生长率  | 36℃±1℃<br>48 h~72 h,<br>厌氧 | 长双歧杆菌婴儿亚种 CICC 6069                         | MRS   | 定量 | PR≥0.7 | 白色圆形凸起菌落  |
| 沙氏葡萄糖琼脂                    | 固体 | 非选择性计数 | 生长率  | 30℃±1℃<br>72 h~120 h       | 酿酒酵母 CMCC(F)98017                           | SDA   | 定量 | PR≥0.7 | 白色圆形菌落    |
|                            |    |        |      |                            | 黑曲霉 CICC 2089                               |       |    |        | 白色菌丝、黑色孢子 |

表 F.1~表 F.7 中的 \* 表示测试菌株中 CMCC 菌种与 ATCC 菌种为等效测试菌种。

表 F.2 选择性分离和计数固体培养基质量控制标准

| 培养基              | 状态 | 功能分类  | 质控指标 | 培养条件              | 测试菌株*                                                                    | 参比培养基 | 方法 | 质控评定标准 | 特征性反应                                                   |
|------------------|----|-------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|---------------------------------------------------------|
| 亚硫酸铋琼脂(BS)       | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>40h~48h | 肠沙门氏菌肠炎亚种伤寒血清型<br>CMCC(B)50071                                           | TSA   | 定量 | PR≥0.5 | 黑色菌落,有金属光泽                                              |
|                  |    |       | 选择性  |                   | 肠沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50976 或 ATCC 14028                             |       |    |        | 黑色或灰绿色菌落,有金属光泽                                          |
|                  |    |       |      |                   | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922<br>粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212 |       |    |        | —                                                       |
| HE 琼脂            | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18h~24h | 肠沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50976<br>或 ATCC 14028                          | TSA   | 定量 | PR≥0.5 | 绿-蓝色菌落,有黑心                                              |
|                  |    |       | 选择性  |                   | 福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572<br>粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212                 |       |    |        | —                                                       |
|                  |    |       |      |                   | —                                                                        |       |    |        | —                                                       |
| 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂(XLD) | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18h~24h | 肠沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50976<br>或 ATCC 14028                          | TSA   | 定量 | PR≥0.5 | 黑色菌落                                                    |
|                  |    |       | 选择性  |                   | 福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572<br>金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538               |       |    |        | 无色菌落,无黑心                                                |
|                  |    |       |      |                   | —                                                                        |       |    |        | —                                                       |
| 沙 门 氏 菌 显 色 培养基  | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18h~24h | 肠沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50976 或 ATCC 14028                             | TSA   | 定量 | PR≥0.5 | 按说明书判定                                                  |
|                  |    |       | 特异性  |                   | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922                                      |       |    |        | —                                                       |
|                  |    |       |      |                   | 选择性                                                                      |       |    |        | 奇异变形菌 CMCC(B)49005<br>粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212 |
|                  |    |       | —    |                   |                                                                          |       |    |        | —                                                       |

表 F.2 选择性分离和计数固体培养基质量控制标准（续）

| 培养基        | 状态 | 功能分类  | 质控指标 | 培养条件                | 测试菌株*                                    | 参比培养基 | 方法  | 质控评定标准 | 特征性反应              |
|------------|----|-------|------|---------------------|------------------------------------------|-------|-----|--------|--------------------|
| PALCAM 琼脂  | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>24 h~48 h | 单核细胞增生李斯特氏菌<br>CMCC(B)54012 或 ATCC 19115 | TSA   | 定量  | PR≥0.5 | 灰绿色菌落，中心凹陷黑色，周围有黑色 |
|            |    |       | 选择性  |                     | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922      | —     | 半定量 | G≤1    | —                  |
|            |    |       |      |                     | 粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212        |       |     |        |                    |
| 麦康凯琼脂(MAC) | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>20 h~24 h | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922      | TSA   | 定量  | PR≥0.5 | 鲜桃红色或粉红色，可有胆酸沉淀    |
|            |    |       | 选择性  |                     | 福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572                      |       |     |        | 无色至浅粉红色，半透明棕色或绿色菌落 |
|            |    |       |      |                     | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538      | —     | 半定量 | G≤1    | —                  |
| 阪崎肠杆菌显色培养基 | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>24 h±2 h  | 阪崎克罗诺杆菌 CICC 21645<br>或 ATCC 29544       | TSA   | 定量  | PR≥0.5 | 按说明书判定             |
|            |    |       | 特异性  |                     | 普通变形菌 CMCC(B)49027                       |       | 定性  | —      | 按说明书判定             |
|            |    |       | 选择性  |                     | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922      | —     |     | —      | 按说明书判定             |
|            |    |       |      |                     | 粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212        |       | 半定量 | G≤1    | —                  |
| CIN-1 培养基  | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 26℃±1℃<br>48 h±2 h  | 小肠结肠炎耶尔森氏菌<br>CMCC(B)52204               | TSA   | 定量  | PR≥0.5 | 红色牛眼状菌落            |
|            |    |       | 选择性  |                     | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922      |       |     |        |                    |
|            |    |       |      |                     | 金黄色葡萄球菌<br>CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538   | —     | 半定量 | G≤1    | —                  |

表 F.2 选择性分离和计数固体培养基质量控制标准 (续)

| 培养基                 | 状态 | 功能分类  | 质控指标 | 培养条件                | 测试菌株*                                                   | 参比培养基 | 方法  | 质控评定标准 | 特征性反应          |
|---------------------|----|-------|------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----|--------|----------------|
| 改良 Y 培养基            | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 26℃±1℃<br>48 h±2 h  | 小肠结肠炎耶尔森氏菌<br>CMCC(B)52204                              | TSA   | 定量  | PR≥0.5 | 无色透明不黏稠菌落      |
|                     |    |       | 特异性  |                     | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922                     | —     | 定性  | —      | 粉红色菌落          |
|                     |    |       | 选择性  |                     | 金黄色葡萄球菌<br>CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538                  | —     | 半定量 | G≤1    | —              |
| 伊红美蓝琼脂(EMB)         | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h~24 h | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922                     | TSA   | 定量  | PR≥0.5 | 黑色菌落,具金属光泽     |
|                     |    |       | 特异性  |                     | 肠沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50976 或 ATCC 14028            | —     | 定性  | —      | 菌落呈无色、半透明      |
|                     |    |       | 选择性  |                     | 金黄色葡萄球菌<br>CMCC(B)26305 或 ATCC 6538                     | —     | 半定量 | G<5    | —              |
| 改良山梨醇麦康凯琼脂(CT-SMAC) | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h~24 h | 大肠埃希氏菌 O157:H7<br>CMCC(B)44939                          | TSA   | 定量  | PR≥0.5 | 无色菌落,中心呈较暗的灰褐色 |
|                     |    |       | 特异性  |                     | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922                     | —     | 定性  | —      | 粉红色菌落,周围有胆盐沉淀  |
|                     |    |       | 选择性  |                     | 金黄色葡萄球菌<br>CMCC(B)26305 或 ATCC 6538                     | —     | 半定量 | G≤1    | —              |
| 大肠埃希氏菌 O157显色培养基    | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h~24 h | 大肠埃希氏菌 O157:H7<br>CMCC(B)44939                          | TSA   | 定量  | PR≥0.5 | 按说明书判定         |
|                     |    |       | 特异性  |                     | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922                     | —     | 定性  | —      | 按说明书判定         |
|                     |    |       | 选择性  |                     | 粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212<br>奇异变形菌 CMCC(B)49005 | —     | 半定量 | G≤1    | —              |

表 F.2 选择性分离和计数固体培养基质量控制标准（续）

| 培养基              | 状态 | 功能分类  | 质控指标 | 培养条件                       | 测试菌株*                                       | 参比培养基             | 方法  | 质控评定标准 | 特征性反应                   |
|------------------|----|-------|------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----|--------|-------------------------|
| 李斯特氏菌显色培养基       | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>24 h~48 h        | 单核细胞增生李斯特氏菌<br>CMCC(B)54012<br>或 ATCC 19115 | TSA               | 定量  | PR≥0.5 | 按说明书判定                  |
|                  |    |       | 特异性  |                            | 英诺克李斯特氏菌<br>CMCC(B)54103<br>或 ATCC 33090    | —                 | 定性  | —      | 按说明书判定                  |
|                  |    |       | 选择性  |                            | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922         |                   | 半定量 | G≤1    | —                       |
|                  |    |       |      |                            | 粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212           |                   |     |        |                         |
| 志贺氏菌显色培养基        | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>20 h~24 h        | 福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572                         | TSA               | 定量  | PR≥0.5 | 按说明书判定                  |
|                  |    |       | 特异性  |                            | 痢疾志贺氏菌 CMCC(B)51105                         | —                 | 定性  | —      | 按说明书判定                  |
|                  |    |       | 选择性  |                            | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922         |                   | —   | 半定量    | G≤1                     |
|                  |    |       |      |                            | 产气克雷伯氏菌 CMCC(B)45108<br>或 ATCC 13048        |                   |     |        |                         |
| 改良 CCD (mCCD) 琼脂 | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 42℃±1℃<br>24 h~48 h<br>微需氧 | 空肠弯曲菌<br>CMCC(B)22073 或 ATCC 33291          | TSA 添加 5%<br>裂解羊血 | 定量  | PR≥0.5 | 菌落有光泽、潮湿、扁平，<br>呈扩散生长倾向 |
|                  |    |       | 选择性  |                            | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922         | —                 | 半定量 | G≤1    | —                       |
|                  |    |       |      |                            | 金黄色葡萄球菌<br>CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538      |                   |     |        |                         |

表 F.2 选择性分离和计数固体培养基质量控制标准 (续)

| 培养基                                  | 状态 | 功能分类  | 质控指标 | 培养条件                       | 测试菌株*                                 | 参比培养基            | 方法  | 质控评定标准 | 特征性反应                             |
|--------------------------------------|----|-------|------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|--------|-----------------------------------|
| Skirrow 琼脂                           | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 42℃±1℃<br>24 h~48 h<br>微需氧 | 空肠弯曲菌<br>CMCC(B)22073<br>或 ATCC 33291 | TSA 添加5%<br>裂解羊血 | 定量  | PR≥0.5 | 菌落灰色、扁平、湿润有<br>光泽,呈沿接种线向外扩<br>散倾向 |
|                                      |    |       | 选择性  |                            | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922   | —                | 半定量 | G≤1    | —                                 |
|                                      |    |       |      |                            | 金黄色葡萄球菌<br>CMCC(B)26305 或 ATCC 6538   |                  |     |        |                                   |
| 改良纤维二糖-多黏<br>菌素 B-多黏菌素 E<br>(mCPC)琼脂 | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h±1 h         | 创伤弧菌 CMCC(B)17244<br>或 ATCC 27562     | 3%氯化钠<br>TSA     | 定量  | PR≥0.1 | 圆形扁平,中心不透明,<br>边缘透明的黄色菌落          |
|                                      |    |       | 特异性  |                            | 霍乱弧菌 CICC 23794                       | —                | 定性  | —      | 紫色菌落                              |
|                                      |    |       | 选择性  |                            | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802    |                  | 半定量 | G≤1    | —                                 |
| 纤维二糖-多黏菌素<br>E(CC)琼脂                 | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h±1 h         | 创伤弧菌 CMCC(B)17244<br>或 ATCC 27562     | 3%氯化钠<br>TSA     | 定量  | PR≥0.5 | 圆形扁平,中心不透明,<br>边缘透明的黄色菌落          |
|                                      |    |       | 特异性  |                            | 霍乱弧菌 CICC 23794                       | —                | 定性  | —      | 紫色菌落                              |
|                                      |    |       | 选择性  |                            | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802    |                  | 半定量 | G≤1    | —                                 |
| 硫代硫酸钠-柠檬酸<br>盐-胆盐-蔗糖琼脂<br>(TCBS)     | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h~24 h        | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802    | 3%氯化钠<br>TSA     | 定量  | PR≥0.2 | 绿色菌落                              |
|                                      |    |       | 选择性  |                            | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922   | —                | 半定量 | G≤1    | —                                 |
|                                      |    |       |      |                            | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802    | 3%氯化钠<br>TSA     | 定量  | PR≥0.5 | 按说明书判定                            |
| 弧菌显色培养基                              | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h~24 h        | 霍乱弧菌 CICC 23794                       | —                | 定性  | —      | 按说明书判定                            |
|                                      |    |       | 特异性  |                            | 溶藻弧菌 CMCC(B)20100<br>或 ATCC 33787     |                  |     |        | 按说明书判定                            |
|                                      |    |       | 选择性  |                            | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922   | —                | 半定量 | G≤1    | —                                 |

表 F.2 选择性分离和计数固体培养基质量控制标准 (续)

| 培养基              | 状态 | 功能分类  | 质控指标 | 培养条件                      | 测试菌株*                                | 参比培养基    | 方法  | 质控评定标准 | 特征性反应                         |
|------------------|----|-------|------|---------------------------|--------------------------------------|----------|-----|--------|-------------------------------|
| 哥伦比亚 CNA 血琼脂     | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18h~24h<br>厌氧培养 | 乙型溶血性链球菌<br>CMCC(B)32210             | TSA+5%羊血 | 定量  | PR≥0.5 | 灰白色圆形表面凸起边缘整齐的光滑半透明菌落,周围有β溶血环 |
|                  |    |       | 特异性  |                           |                                      |          |     |        |                               |
|                  |    |       | 选择性  |                           | 肺炎链球菌 CMCC(B)33412                   | —        | 定性  |        | 白色圆形凸起菌落,菌落周围有α溶血环            |
| 改良马铃薯葡萄糖琼脂(mPDA) | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>24h~48h         | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌<br>CMCC(B)10802           | TSA      | 定量  | PR≥0.5 | 紫色,光滑、湿润、边缘整齐;部分菌落中心可有呈草帽状凸起  |
|                  |    |       | 选择性  |                           |                                      |          |     |        |                               |
|                  |    |       | 选择性  |                           | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201                  | —        | 半定量 | G≤1    | —                             |
| PCFA             | 固体 | 选择性分离 | 生长率  | 36℃±1℃<br>24h~48h         | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌<br>CMCC(B)10802           | TSA      | 定量  | PR≥0.5 | 灰白色,光滑、湿润、边缘整齐                |
|                  |    |       | 选择性  |                           |                                      |          |     |        |                               |
|                  |    |       | 选择性  |                           | 粪肠球菌 CMCC(B)32482                    | —        | 半定量 | G≤1    | —                             |
| Baird-Parker 琼脂  | 固体 | 选择性计数 | 生长率  | 36℃±1℃<br>24h~48h         | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26305<br>或 ATCC 25923 | TSA      | 定量  | PR≥0.7 | 菌落黑色凸起,周围有一浑浊带,在其外层有一透明圈      |
|                  |    |       | 特异性  |                           |                                      |          |     |        |                               |
|                  |    |       | 选择性  |                           | 表皮葡萄球菌 CMCC(B)26069                  | —        | 定性  | —      | 黑色菌落,无浑浊带和透明圈                 |
| 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 固体 | 选择性计数 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18h~24h         | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922  | —        | 半定量 | G≤1    | —                             |
|                  |    |       | 选择性  |                           |                                      |          |     |        |                               |
|                  |    |       | 选择性  |                           | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922  | TSA      | 定量  | PR≥0.7 | 有或无沉淀环的紫红色或红色菌落               |
|                  |    |       | 生长率  |                           | 弗氏柠檬酸杆菌 CMCC(B)48098<br>或 ATCC 43864 |          |     |        |                               |
|                  |    |       | 选择性  |                           |                                      |          |     |        |                               |
|                  |    |       | 选择性  |                           | 粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212    | —        | 半定量 | G<5    | —                             |

表 F.2 选择性分离和计数固体培养基质量控制标准 (续)

| 培养基                                    | 状态                                  | 功能分类                             | 质控指标           | 培养条件              | 测试菌株*                                | 参比培养基                                                     | 方法    | 质控评定标准       | 特征性反应                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------|
| 结晶紫中性红胆盐-4-甲基伞形酮-β-D-葡萄糖苷琼脂 (VRBA-MUG) | 固体                                  | 选择性计数                            | 生长率            | 36℃±1℃<br>18h~24h | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922  | TSA                                                       | 定量    | PR≥0.7       | 带有沉淀环的紫红色或红色菌落,有荧光               |
|                                        |                                     |                                  | 特异性            |                   | 弗氏柠檬酸杆菌 CMCC(B)48098<br>或 ATCC 43864 | —                                                         | 定性    | —            | 可带有沉淀环的红色菌落,无荧光                  |
|                                        |                                     |                                  | 选择性            |                   | 粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212    |                                                           | 半定量   | G<5          | —                                |
|                                        |                                     |                                  | 马铃薯葡萄糖琼脂 (PDA) |                   | 固体                                   | 选择性计数                                                     | 生长率   | 28℃±1℃<br>5d | 酿酒酵母 CMCC(F)98017<br>或 ATCC 9763 |
| 黑曲霉 CICC 2089<br>或 ATCC 16404          | 定量                                  | PR≥0.7                           |                | 白色菌丝,黑色孢子         |                                      |                                                           |       |              |                                  |
| 选择性                                    | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922 | —                                |                | 半定量               |                                      |                                                           | G≤1   |              | —                                |
| 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538    | SDA                                 | 定量                               |                | PR≥0.7            |                                      |                                                           | 奶油色菌落 |              |                                  |
| 选择性                                    |                                     | 酿酒酵母 CMCC(F)98017<br>或 ATCC 9763 | 定量             | PR≥0.7            | 白色菌丝,黑色孢子                            |                                                           |       |              |                                  |
| 孟加拉红琼脂                                 | 固体                                  | 选择性计数                            | 生长率            | 28℃±1℃<br>5d      | 黑曲霉 CICC 2089<br>或 ATCC 16404        | —                                                         | 半定量   | G≤1          | —                                |
|                                        |                                     |                                  | 选择性            |                   | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922  |                                                           |       |              |                                  |
|                                        |                                     |                                  | 生长率            |                   | 36℃±1℃<br>72h±2h<br>厌氧培养             | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538                       | 半定量   | G≤1          | —                                |
|                                        |                                     |                                  | 选择性            |                   |                                      | 长双歧杆菌婴儿亚种 CICC 6069<br>瑞士乳杆菌 CICC 6032<br>嗜热链球菌 CICC 6038 | —     | 半定量          | G≤1                              |

表 F.2 选择性分离和计数固体培养基质量控制标准（续）

| 培养基                   | 状态 | 功能分类  | 质控指标                    | 培养条件                        | 测试菌株*                               | 参比培养基        | 方法  | 质控评定标准 | 特征性反应              |
|-----------------------|----|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|-----|--------|--------------------|
| 甘露醇卵黄多黏菌素琼脂(MYP)      | 固体 | 选择性计数 | 生长率                     | 30℃±1℃<br>24 h~48 h         | 蜡样芽孢杆菌 CMCC(B)63303                 | TSA          | 定量  | PR≥0.7 | 菌落为微粉红色,周围有淡粉红色沉淀环 |
|                       |    |       | 特异性                     |                             | 枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63542<br>或 ATCC 6633  | —            | 定性  | —      | 黄色菌落,无沉淀环          |
|                       |    |       | 选择性                     |                             | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922 | —            | 半定量 | G≤1    | —                  |
| 胰陈-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂(TSC)   | 固体 | 选择性计数 | 生长率                     | 36℃±1℃<br>20 h~24 h<br>厌氧培养 | 产气荚膜梭菌 CMCC(B)64724<br>或 ATCC 13124 | TSA+<br>5%羊血 | 定量  | PR≥0.7 | 黑色菌落               |
|                       |    |       | 选择性                     |                             | 艰难梭菌 CMCC(B)64967<br>或 ATCC 43593   | —            | 半定量 | G≤1    | —                  |
| 结晶紫中性红葡萄糖胆盐琼脂(VRB-GA) | 固体 | 选择性计数 | 生长率                     | 36℃±1℃<br>24 h±2 h          | 大肠埃希氏菌<br>CMCC(B)43201              | TSA          | 定量  | PR≥0.7 | 紫红色菌落,周围有胆盐沉淀环     |
|                       |    |       | 弗氏柠檬酸杆菌<br>CMCC(B)48098 |                             |                                     |              |     |        |                    |
|                       |    |       | 金黄色葡萄球菌<br>CMCC(B)26305 |                             | —                                   |              |     |        |                    |

表 F.3 非选择性增菌培养基质量控制标准

| 培养基                       | 状态 | 功能分类   | 质控指标 | 培养条件                | 测试菌株*                                      | 接种计数培养基  | 方法  | 质控评定标准 |
|---------------------------|----|--------|------|---------------------|--------------------------------------------|----------|-----|--------|
| 含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆肉汤(TSB-YE) | 液体 | 非选择性增菌 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h~24 h | 单核细胞增生李斯特氏菌 CMCC(B)54012<br>或 ATCC 19115   | TSA      | 半定量 | 浑浊度 2  |
| 液体硫乙醇酸盐培养基(FTG)           | 液体 | 非选择性增菌 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h~24 h | 产气荚膜梭菌 CMCC(B)64724<br>或 ATCC 13124        | TSA+5%羊血 | 半定量 | 浑浊度 2  |
| 缓冲蛋白胨水(BPW)               | 液体 | 非选择性增菌 | 生长率  | 36℃±1℃<br>8 h~18 h  | 肠沙门氏菌肠炎鼠伤寒血清型 CMCC(B)50976<br>或 ATCC 14028 | TSA      | 半定量 | 浑浊度 2  |

表 F.3 非选择性增菌培养基质量控制标准 (续)

| 培养基                             | 状态 | 功能分类   | 质控指标 | 培养条件                        | 测试菌株*                                  | 接种计数培养基        | 方法  | 质控评定标准            |
|---------------------------------|----|--------|------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|-------------------|
| 脑心浸出液肉汤<br>(BHI)                | 液体 | 非选择性增菌 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h~24 h         | 金黄色葡萄球菌<br>CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538 | TSA            | 半定量 | 浑浊度 2             |
| 布氏肉汤                            | 液体 | 非选择性增菌 | 生长率  | 42℃±1℃<br>18 h~24 h,<br>微需氧 | 空肠弯曲菌 CMCC(B)22073<br>或 ATCC 33291     | TSA+5%<br>裂解羊血 | 半定量 | 浑浊度 1~2           |
| 营养肉汤(NB)                        | 液体 | 非选择性增菌 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h~24 h         | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201                    | TSA            | 半定量 | 浑浊度 2 或菌成片状<br>生长 |
|                                 |    |        |      |                             | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26305                   |                |     |                   |
|                                 |    |        |      |                             | 枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63542                    |                |     |                   |
| 3%氯化钠碱性蛋白<br>胨水                 | 液体 | 非选择性增菌 | 生长率  | 36℃±1℃<br>8 h~18 h          | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802     | 3%氯化钠 TSA      | 半定量 | 浑浊度 2             |
| 胰蛋白胨大豆肉汤<br>(TSB)               | 液体 | 非选择性增菌 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h~24 h         | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201                    | TSA            | 半定量 | 浑浊度 2 或菌成片状<br>生长 |
|                                 |    |        |      |                             | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26305                   |                |     |                   |
|                                 |    |        |      |                             | 枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63542                    |                |     |                   |
| 庖肉培养基                           | 液体 | 非选择性增菌 | 生长率  | 35℃±1℃<br>5 d,厌氧            | 生孢梭菌 CMCC(B)64942                      | TSA+5%羊血       | 半定量 | 浑浊度 1~2           |
| 胰蛋白胨胰蛋白胨<br>葡萄糖酵母膏肉汤<br>(TPGYT) | 液体 | 非选择性增菌 | 生长率  | 28℃±1℃<br>5 d,厌氧            | 生孢梭菌 CMCC(B)64942                      | TSA+5%羊血       | 半定量 | 浑浊度 1~2           |
| 麦芽浸膏汤                           | 液体 | 非选择性增菌 | 生长率  | 30℃±1℃<br>5 d               | 酿酒酵母 CMCC(F)98017                      | SDA            | 半定量 | 浑浊度 2             |
| PYG 液体培养基                       | 液体 | 非选择性增加 | 生长率  | 36℃±1℃<br>48 h±2 h,厌氧       | 长双歧杆菌婴儿亚种<br>CICC 6069                 | MRS            | 半定量 | 浑浊度 2             |

表 F.4 选择性增菌培养基质量控制标准

| 培养基                  | 状态 | 功能分类      | 质控指标 | 培养条件                         | 测试菌株*                                       | 接种计数培养基        | 方法                                          | 质控评定标准                                      | 特征性反应                                     |
|----------------------|----|-----------|------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 李氏增菌肉汤<br>(LB1, LB2) | 液体 | 选择性<br>增菌 | 生长率  | 30℃±1℃<br>24 h±2 h           | 单核细胞增生李斯特氏菌<br>CMCC(B)54012<br>或 ATCC 19115 | TSA            | 半定量 (LB2 目<br>标菌接 种 量 为<br>300 CFU~500 CFU) | 在 PALCAM 上<br>>10 CFU                       | 灰色至黑色菌落，<br>带有黑色晕环                        |
|                      |    |           | 选择性  |                              | 大肠埃希氏菌<br>CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922      |                |                                             | 在 TSA 上<br><100 CFU                         | —                                         |
|                      |    |           |      |                              | 粪肠球菌<br>CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212        |                |                                             |                                             |                                           |
| Bolton 肉汤            | 液体 | 选择性<br>增菌 | 生长率  | 42℃±1℃<br>24 h~48 h<br>微需氧培养 | 空肠弯曲菌<br>CMCC(B)22073<br>或 ATCC 33291       | TSA+5%<br>裂解羊血 | 半定量                                         | 空肠弯曲菌在<br>TSA 添加 5%<br>裂解羊血 平 板<br>上>10 CFU | 菌落呈灰白色                                    |
|                      |    |           | 选择性  |                              | 金黄色葡萄球菌<br>CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538      | TSA            |                                             | 在 TSA 上<br><100 CFU                         | —                                         |
|                      |    |           |      |                              | 大肠埃希氏菌<br>CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922      |                |                                             |                                             |                                           |
| 改良胰蛋白胨大<br>豆肉汤(mTSB) | 液体 | 选择性<br>增菌 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h~24 h          | 乙型溶血性链球菌<br>CMCC(B)32210                    | TSA+5%<br>裂解羊血 | 半定量                                         | 在 哥 伦 比 亚<br>CNA 血 琼 脂 上<br>>10 CFU         | 灰白色圆形表面<br>凸起边缘整齐的<br>光滑半透明菌落，<br>周围有β溶血环 |
|                      |    |           | 选择性  |                              | 大肠埃希氏菌<br>CMCC(B)43201                      | —              |                                             | 在 TSA 上<br><100 CFU                         | —                                         |

表 F.4 选择性增菌培养基质量控制标准 (续)

| 培养基                | 状态 | 功能分类  | 质控指标 | 培养条件                | 测试菌株*                                           | 接种计数培养基 | 方法  | 质控评定标准                      | 特征性反应                      |
|--------------------|----|-------|------|---------------------|-------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------|----------------------------|
| 缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤(EE 肉汤) | 液体 | 选择性增菌 | 生长率  | 36℃±1℃<br>24 h±2 h  | 大肠埃希氏菌<br>CMCC(B)43201                          | TSA     | 半定量 | 在 VRBGA 上<br>>10 CFU        | 红色菌落, 周围有胆盐沉淀环             |
|                    |    |       | 选择性  |                     | 肠沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50976                 |         |     |                             |                            |
|                    |    |       |      |                     | 金黄色葡萄球菌<br>CMCC(B)26305                         |         |     | 在 TSA 上<br><100 CFU         | —                          |
| 四硫酸酸钠煌绿增菌液(TTB)    | 液体 | 选择性增菌 | 生长率  | 42℃±1℃<br>18 h~24 h | 肠沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50976<br>或 ATCC 14028 | TSA     | 半定量 | 在 XLD 上<br>>10 CFU          | 菌落无色半透明, 有黑心               |
|                    |    |       | 选择性  |                     | 大肠埃希氏菌<br>CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922          |         |     |                             |                            |
|                    |    |       |      |                     | 粪肠球菌<br>CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212            |         |     | 在 TSA 上<br><100 CFU         | —                          |
| 亚硝酸盐脱氨酸增菌液(SC)     | 液体 | 选择性增菌 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h~24 h | 肠沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50976<br>或 ATCC 14028 | TSA     | 半定量 | 在 XLD 上<br>>10 CFU          | 菌落无色半透明, 有黑心               |
|                    |    |       | 选择性  |                     | 大肠埃希氏菌<br>CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922          |         |     |                             |                            |
|                    |    |       |      |                     | 粪肠球菌<br>CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212            |         |     | 在 TSA 上<br><100 CFU         | —                          |
| 7.5%氯化钠肉汤          | 液体 | 选择性增菌 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h~24 h | 金黄色葡萄球菌<br>CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538          | TSA     | 半定量 | 在 Baird-Parker 上<br>>10 CFU | 菌落黑色凸起, 周围有一浑浊带, 在其外层有一透明圈 |
|                    |    |       | 选择性  |                     | 大肠埃希氏菌<br>CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922          |         |     |                             |                            |
|                    |    |       |      |                     |                                                 |         |     | 在 TSA 上<br><100 CFU         | —                          |

表 F.4 选择性增菌培养基质量控制标准 (续)

| 培养基                                       | 状态 | 功能分类      | 质控指标 | 培养条件                          | 测试菌株*                                                                       | 接种计数培养基 | 方法  | 质控评定标准                      | 特征性反应                      |
|-------------------------------------------|----|-----------|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------|----------------------------|
| 改良磷酸盐缓冲液                                  | 液体 | 选择性<br>增菌 | 生长率  | 26℃±1℃<br>48 h~72 h           | 小肠结肠炎耶尔森氏菌<br>CMCC(B)52204                                                  | TSA     | 半定量 | 在改良 Y 平板<br>上>10 CFU        | 菌落圆形、无色透<br>明,不黏稠          |
|                                           |    |           | 选择性  |                               | 金黄色葡萄球菌<br>CMCC(B)26305 或<br>ATCC 6538<br>粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212 |         |     | 在 TSA 上<br><100 CFU         | —                          |
| 改良月桂基硫酸<br>盐胰蛋白胨肉汤-<br>万古霉素 (mLST-<br>Vm) | 液体 | 选择性<br>增菌 | 生长率  | 44℃±0.5℃<br>24 h±2 h          | 阪崎克罗诺杆菌<br>CICC 21645<br>或 ATCC 29544                                       | TSA     | 半定量 | 在阪崎肠杆菌<br>显色培养基上<br>>10 CFU | 绿-蓝色菌落或按<br>说明书判定          |
|                                           |    |           | 选择性  |                               | 粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212                                           |         |     | 在 TSA 上<br><100 CFU         | —                          |
| 胰酪胨大豆多黏<br>菌素肉汤                           | 液体 | 选择性<br>增菌 | 生长率  | 30℃±1℃<br>24 h±2 h            | 蜡样芽孢杆菌<br>CMCC(B)63303                                                      | TSA     | 半定量 | 在 MYP 上<br>>10 CFU          | 菌落为微粉红色,<br>周围有淡粉红色<br>沉淀环 |
|                                           |    |           | 选择性  |                               | 大肠埃希氏菌<br>CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922                                      |         |     | 在 TSA 上<br><100 CFU         | —                          |
| 志贺氏菌增菌肉汤                                  | 液体 | 选择性<br>增菌 | 生长率  | 41.5℃±1℃<br>16 h~20 h<br>厌氧培养 | 福氏志贺氏菌<br>CMCC(B)51572                                                      | TSA     | 半定量 | 在 XLD 上<br>>10 CFU          | 无色至粉红色,半<br>透明菌落           |
|                                           |    |           | 选择性  |                               | 金黄色葡萄球菌<br>CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538                                      |         |     | 在 TSA 上<br><100 CFU         | —                          |
| 改良 EC 肉汤<br>(mEC+n)                       | 液体 | 选择性<br>增菌 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18 h~24 h           | 大肠埃希氏菌 O157:<br>H7 CMCC(B)44939                                             | TSA     | 半定量 | 在 CT-SMAC 上<br>>10 CFU      | 菌落无色,中心灰<br>褐色             |
|                                           |    |           | 选择性  |                               | 粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212                                           |         |     | 在 TSA 上<br><100 CFU         | —                          |

表 F.4 选择性增菌培养基质量控制标准（续）

| 培养基              | 状态 | 功能分类      | 质控指标 | 培养条件                | 测试菌株*                                  | 接种计数培养基 | 方法  | 质控评定标准                 | 特征性反应                        |
|------------------|----|-----------|------|---------------------|----------------------------------------|---------|-----|------------------------|------------------------------|
| 改良麦康凯（CT-MAC）肉汤  | 液体 | 选择性<br>增菌 | 生长率  | 36℃±1℃<br>18h~24h   | 大肠埃希氏菌 O157：<br>H7 CMCC(B)4939         | TSA     | 半定量 | 在 CT-SMAC 上<br>>10 CFU | 菌落无色，中心灰<br>褐色               |
|                  |    |           | 选择性  |                     | 大肠埃希氏菌<br>CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922 |         |     | 在 TSA 上<br><100 CFU    | —                            |
|                  |    |           |      |                     | 金黄色葡萄球菌<br>CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538 |         |     |                        |                              |
| 志贺氏菌增菌液<br>(BCT) | 液体 | 选择性<br>增菌 | 生长率  | 41.5℃±1℃<br>16h~20h | 福氏志贺氏菌<br>CMCC(B)51572                 | TSA     | 半定量 | 在 XLD 上<br>>10 CFU     | 无色透明菌落                       |
|                  |    |           | 选择性  |                     | 金黄色葡萄球菌<br>CMCC(B)26305                |         |     | 在 TSA 上<br><10 CFU     | —                            |
| GVC 增菌液          | 液体 | 选择性<br>增菌 | 生长率  | 36℃±1℃<br>20h~24h   | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌<br>CMCC(B)10802             | TSA     | 半定量 | 在 PDA 上<br>>10 CFU     | 灰白或乳白色，中<br>心凸起，草帽状<br>(不明显) |
|                  |    |           | 选择性  |                     | 大肠埃希氏菌<br>CMCC(B)43201                 | TSA     |     | 在 TSA 上<br><100 CFU    | —                            |

表 F.5 选择性液体计数培养基质量控制标准

| 培养基                   | 状态 | 功能分类        | 质控指标 | 培养条件              | 测试菌株*                                | 接种计数培养基 | 方法  | 质控评定标准               |
|-----------------------|----|-------------|------|-------------------|--------------------------------------|---------|-----|----------------------|
| 月桂基硫酸盐胰<br>蛋白胨肉汤(LST) | 液体 | 选择性<br>液体计数 | 生长率  | 36℃±1℃<br>24h~48h | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922  | TSA     | 半定量 | 浑浊度 2,且气体充满管内<br>1/3 |
|                       |    |             |      |                   | 弗氏柠檬酸杆菌 CMCC(B)48098<br>或 ATCC 43864 |         |     |                      |
|                       |    |             | 选择性  |                   | 粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212    |         |     | 浑浊度 0(不生长)           |

表 F.5 选择性液体计数培养基质量控制标准 (续)

| 培养基            | 状态 | 功能分类        | 质控指标 | 培养条件                     | 测试菌株*                                | 接种计数培养基 | 方法  | 质控评定标准                     |
|----------------|----|-------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---------|-----|----------------------------|
| 煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB) | 液体 | 选择性<br>液体计数 | 生长率  | 36 ℃±1 ℃<br>48 h±2 h     | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922  | TSA     | 半定量 | 浑浊度 2,且气体充满管内 1/3          |
|                |    |             | 选择性  |                          | 弗氏柠檬酸杆菌 CMCC(B)48098<br>或 ATCC 43864 |         |     | 浑浊度 0(不生长)或浑浊度 1(微弱生长),不产气 |
|                |    |             |      |                          | 粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212    |         |     | 浑浊度 2,且气体充满管内 1/3          |
| EC 肉汤          | 液体 | 选择性<br>液体计数 | 生长率  | 44.5 ℃±0.2 ℃<br>48 h±2 h | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922  | TSA     | 半定量 | 浑浊度 2,且气体充满管内 1/3          |
|                |    |             | 选择性  |                          | 粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212    |         |     | 浑浊度 0(不生长)                 |

表 F.6 悬浮培养基和运输培养基质量控制标准

| 培养基         | 状态 | 功能分类      | 质控指标 | 放置条件                | 测试菌株*                               | 接种计数培养基   | 方法 | 质控评定标准           |
|-------------|----|-----------|------|---------------------|-------------------------------------|-----------|----|------------------|
| 磷酸盐缓冲液(PBS) | 液体 | 悬浮<br>培养基 | 生长率  | 20 ℃~25 ℃<br>45 min | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922 | TSA       | 定量 | 放置培养前后菌落数变化在±50% |
|             |    |           |      |                     | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538 |           |    |                  |
| 3%氯化钠溶液     | 液体 | 悬浮<br>培养基 | 生长率  | 20 ℃~25 ℃<br>45 min | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802  | 3%氯化钠 TSA | 定量 | 放置培养前后菌落数变化在±50% |
| 0.1%蛋白胨水    | 液体 | 悬浮<br>培养基 | 生长率  | 20 ℃~25 ℃<br>45 min | 产气荚膜梭菌 CMCC(B)64724<br>或 ATCC 13124 | TSA+5%羊血  | 定量 | 放置培养前后菌落数变化在±50% |
| 缓冲甘油-氯化钠溶液  | 液体 | 运输<br>培养基 | 生长率  | —60 ℃<br>24 h±2     | 产气荚膜梭菌 CMCC(B)64724<br>或 ATCC 13124 | TSA+5%羊血  | 定量 | 放置培养前后菌落数变化在±50% |

表 F.7 鉴定培养基和实验试剂质量控制标准

| 培养基                  | 状态       | 功能分类 | 质控指标 | 培养条件                | 测试菌株*                                       | 方法 | 质控评定标准                                |
|----------------------|----------|------|------|---------------------|---------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 三糖铁琼脂(TSI)           | 高层<br>斜面 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h  | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922         | 定性 | 生长良好, A/A; 产气; 不产硫化氢 <sup>a</sup>     |
|                      |          |      |      |                     | 肠沙门氏菌肠炎种 CMCC(B)50335                       |    | 生长良好, K/A; 产气; 产硫化氢 <sup>a, b</sup>   |
|                      |          |      |      |                     | 福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572                         |    | 生长良好, K/A; 不产气; 不产硫化氢                 |
|                      |          |      |      |                     | 铜绿假单胞菌 CMCC(B)10901<br>或 ATCC 27853         |    | 生长良好, K/K; 不产气; 不产硫化氢                 |
| 西蒙氏柠檬酸盐培养基           | 斜面       | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h  | 肺炎克雷伯氏菌 CMCC(B)46117                        | 定性 | 生长良好, 培养基变蓝                           |
|                      |          |      |      |                     | 宋内志贺氏菌 CMCC(B)51592                         |    | 生长不良或不长, 培养基不变色                       |
| 尿素琼脂(pH7.2)          | 斜面       | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h  | 普通变形菌 CMCC(B)49027                          | 定性 | 生长良好, 培养基变桃红色                         |
|                      |          |      |      |                     | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922         |    | 生长良好, 培养基变黄色                          |
| 醋酸盐利用试验              | 斜面       | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h~48 h | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922         | 定性 | 阳性, 培养基变蓝色                            |
|                      |          |      |      |                     | 宋内志贺氏菌 CMCC(B)51592                         |    | 阴性, 培养基不变色(绿色)                        |
| 3%氯化钠三糖铁琼脂           | 高层<br>斜面 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>18 h~24 h | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802          | 定性 | 生长良好, 斜面变红, 底部变黄                      |
|                      |          |      |      |                     | 溶藻弧菌 CMCC(B)20100<br>或 ATCC 33787           |    | 生长良好, 斜面和底部均变黄                        |
| 改良克氏双糖               | 高层<br>斜面 | 鉴定   | 生化特性 | 26℃±1℃<br>24 h±2 h  | 小肠结肠炎耶尔森氏菌 CMCC(B)52204                     | 定性 | 生长良好, A/A; 不产气; 不产硫化氢 <sup>a</sup>    |
|                      |          |      |      |                     | 肠沙门氏菌肠炎种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50976 或 ATCC 14028 |    | 生长良好, A/A; 产气, 产硫化氢                   |
|                      |          |      |      |                     | 福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572                         |    | 生长良好, K/A; 不产气, 不产硫化氢 <sup>a, b</sup> |
|                      |          |      |      |                     | 支气管肺炎鲍特氏菌 CMCC(B)40001                      |    | 生长良好, K/K; 不产气, 不产硫化氢                 |
| 邻硝基酚β-D半乳糖苷培养基(ONPG) | 液体       | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>18 h~24 h | 肺炎克雷伯氏菌 CMCC(B)46117                        | 定性 | 阳性, 培养基变深黄色                           |
|                      |          |      |      |                     | 肠沙门氏菌肠炎种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50071              |    | 阴性, 培养基无色或浅黄色                         |

表 F.7 鉴定培养基和实验试剂质量控制标准（续）

| 培养基                                 | 状态 | 功能分类       | 质控指标 | 培养条件              | 测试菌株*                                        | 方法 | 质控评定标准                                                            |
|-------------------------------------|----|------------|------|-------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 蛋白胨水（靛基质试验）                         | 液体 | 鉴定<br>试验试剂 | 生化特性 | 36℃±1℃<br>18h~24h | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922          | 定性 | 阳性，滴加靛基质试剂，显红色                                                    |
|                                     |    |            |      |                   | 产气克雷伯氏菌 CMCC(B)45108<br>或 ATCC 13048         |    | 阴性，滴加靛基质试剂，黄色                                                     |
| 氰化钾培养基(KCN)                         | 液体 | 鉴定         | 生化特性 | 36℃±1℃<br>18h~24h | 普通变形菌 CMCC(B)49027                           | 定性 | 生长良好，培养基浑浊                                                        |
|                                     |    |            |      |                   | 肠沙门氏菌肠炎亚种伤寒血清型<br>CMCC(B)50071               |    | 不生长，澄清                                                            |
| 氰化钾对照培养基<br>(KCN)                   | 液体 | 鉴定         | 生化特性 | 36℃±1℃<br>18h~24h | 普通变形菌 CMCC(B)49027                           | 定性 | 生长良好，培养基浑浊                                                        |
|                                     |    |            |      |                   | 肠沙门氏菌肠炎亚种伤寒血清型<br>CMCC(B)50071               |    | 生长良好，培养基浑浊                                                        |
| 葡萄糖铵培养基                             | 斜面 | 鉴定         | 生化特性 | 36℃±1℃<br>20h~24h | 肠沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50976 或 ATCC 14028 | 定性 | 生长良好，培养基变黄                                                        |
|                                     |    |            |      |                   | 福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572                          |    | 不生长，培养基不变色                                                        |
| 缓冲葡萄糖蛋白胨水<br>[甲基红 (MR) 和 V-P<br>试验] | 液体 | 鉴定<br>试验试剂 | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24h~48h | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922          | 定性 | 生长良好，滴加 MR 试剂 1 滴，培养基变红。滴加 VP 甲液 0.5 mL 和乙液 0.2 mL，20 min 内液面不显红色 |
|                                     |    |            |      |                   | 产气克雷伯氏菌 CMCC(B)45108<br>或 ATCC 13048         |    | 生长良好，滴加 MR 试剂 1 滴，培养基不变色。滴加 P 甲液 0.5 mL 和乙液 0.2 mL，20 min 内液面显红色  |
| 鼠李糖发酵管                              | 液体 | 鉴定         | 生化特性 | 36℃±1℃<br>18h~24h | 单核细胞增生李斯特氏菌<br>CMCC(B)54012 或 ATCC 19115     | 定性 | 阳性，培养基变黄                                                          |
|                                     |    |            |      |                   | 肠沙门氏菌肠炎亚种伤寒血清型<br>CMCC(B)50071               |    | 阴性，培养基颜色不变                                                        |

表 F.7 鉴定培养基和实验试剂质量控制标准（续）

| 培养基                                                                                                      | 状态 | 功能分类 | 质控指标 | 培养条件                                    | 测试菌株*                                       | 方法 | 质控评定标准      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----|-------------|
| 0.5%蔗糖发酵管<br>0.5%纤维二糖发酵管<br>0.5%麦芽糖发酵管<br>0.5%甘露醇发酵管<br>0.5%水杨苷发酵管<br>0.5%山梨醇发酵管<br>0.5%棉子糖发酵管<br>七叶苷发酵管 | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>18h~24h                       | 植物乳杆菌 CMCC(B)34130                          | 定性 | 阳性,培养基变黄    |
|                                                                                                          |    |      |      |                                         | 瑞士乳杆菌 CICC 6032                             |    | 阴性,培养基紫色不变  |
|                                                                                                          |    |      |      |                                         | 肠沙门氏菌肠炎种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50976 或 ATCC 14028 |    | 阳性,培养基呈紫色   |
|                                                                                                          |    |      |      |                                         | 普通变形菌 CMCC(B)49027                          |    | 阴性,培养基呈黄色   |
|                                                                                                          |    |      |      |                                         | 肠沙门氏菌肠炎种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50976 或 ATCC 14028 |    | 阳性,培养基呈紫色   |
|                                                                                                          |    |      |      |                                         | 普通变形菌 CMCC(B)49027                          |    | 阴性,培养基呈黄色   |
|                                                                                                          |    |      |      |                                         | 与各种氨基酸脱羧酶的阳性和<br>阴性测试菌株对应                   |    | 生长良好,培养基呈黄色 |
| L-赖氨酸脱羧酶培<br>养基                                                                                          | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃,<br>24h±2h<br>以灭菌液体石蜡<br>覆盖培养基表面 | 肠沙门氏菌肠炎种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50976 或 ATCC 14028 | 定性 | 阳性,培养基呈紫色   |
|                                                                                                          |    |      |      |                                         | 普通变形菌 CMCC(B)49027                          |    | 阴性,培养基呈黄色   |
| L-鸟氨酸脱羧酶试<br>验培养基                                                                                        | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃,<br>24h±2h<br>以灭菌液体石蜡<br>覆盖培养基表面 | 肠沙门氏菌肠炎种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50976 或 ATCC 14028 | 定性 | 阳性,培养基呈紫色   |
| 氨基酸脱羧酶对照                                                                                                 | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃,<br>24h±2h<br>以灭菌液体石蜡<br>覆盖培养基表面 | 与各种氨基酸脱羧酶的阳性和<br>阴性测试菌株对应                   | 定性 | 生长良好,培养基呈黄色 |
| L-精氨酸双水解酶培<br>养基                                                                                         | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃,<br>24h±2h<br>以灭菌液体石蜡<br>覆盖培养基表面 | 肠沙门氏菌肠炎种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50976 或 ATCC 14028 | 定性 | 阳性,培养基呈紫色   |
|                                                                                                          |    |      |      |                                         | 普通变形菌 CMCC(B)49027                          |    | 阴性,培养基呈黄色   |

表 F.7 鉴定培养基和实验试剂质量控制标准 (续)

| 培养基       | 状态 | 功能分类 | 质控指标 | 培养条件                                      | 测试菌株*                                       | 方法 | 质控评定标准                               |
|-----------|----|------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----|--------------------------------------|
| 精氨酸双水解酶对照 | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃，<br>24 h±2 h<br>以灭菌液体石蜡<br>覆盖培养基表面 | 肠沙门氏菌肠炎鼠伤寒血清型<br>CMCC(B) 50976 或 ATCC 14028 | 定性 | 生长良好，培养基呈黄色                          |
| 硝酸盐肉汤     | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 30℃±1℃<br>24 h±2 h                        | 蜡样芽孢杆菌 CMCC(B) 63303                        | 定性 | 阳性，滴加硝酸盐还原试剂甲、乙液各<br>2 滴~3 滴，培养基变红棕色 |
|           |    |      |      |                                           | 鲍氏不动杆菌 CMCC(B) 25001                        |    | 阴性，滴加硝酸盐还原试剂甲、乙液各<br>2 滴~3 滴，培养基不变色  |
| 葡萄糖发酵管    | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h                        | 大肠埃希氏菌 CMCC(B) 43201<br>或 ATCC 25922        | 定性 | 阳性，培养基变黄                             |
|           |    |      |      |                                           | 支气管肺炎鲍特氏菌 CMCC(B) 40001                     |    | 阴性，培养基不变色                            |
| 甘露醇发酵管    | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h                        | 大肠埃希氏菌 CMCC(B) 43201<br>或 ATCC 25922        | 定性 | 阳性，培养基变黄色                            |
|           |    |      |      |                                           | 普通变形菌 CMCC(B) 49027                         |    | 阴性，培养基颜色不变                           |
| 木糖发酵管     | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h                        | 肺炎克雷伯氏菌 CMCC(B) 46117                       | 定性 | 阳性，培养基变黄色                            |
|           |    |      |      |                                           | 单核细胞增生李斯特氏菌<br>CMCC(B) 54012 或 ATCC 19115   |    | 阴性，培养基颜色不变                           |
| 蔗糖发酵管     | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h                        | 普通变形菌 CMCC(B) 49027                         | 定性 | 阳性，培养基呈黄色                            |
|           |    |      |      |                                           | 肠沙门氏菌肠炎鼠伤寒血清型<br>CMCC(B) 50976 或 ATCC 14028 |    | 阴性，培养基颜色不变                           |
| 纤维二糖发酵管   | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h                        | 肺炎克雷伯氏菌 CMCC(B) 46117                       | 定性 | 阳性，培养基呈黄色                            |
|           |    |      |      |                                           | 大肠埃希氏菌 CMCC(B) 43201<br>或 ATCC 25922        |    | 阴性，培养基颜色不变                           |

表 F.7 鉴定培养基和实验试剂质量控制标准（续）

| 培养基     | 状态 | 功能分类 | 质控指标 | 培养条件                   | 测试菌株*                               | 方法                      | 质控评定标准     |
|---------|----|------|------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|
| 麦芽糖发酵管  | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h     | 肠沙门氏菌肠炎亚种伤寒血清型<br>CMCC(B)50071      | 定性                      | 阳性,培养基呈黄色  |
|         |    |      |      |                        | 铜绿假单胞菌 CMCC(B)10901<br>或 ATCC 9027  |                         | 阴性,培养基颜色不变 |
| 水杨苷发酵管  | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h     | 肺炎克雷伯氏菌 CMCC(B)46117                | 定性                      | 阳性,培养基变黄   |
|         |    |      |      |                        | 肠沙门氏菌肠炎亚种伤寒血清型<br>CMCC(B)50071      |                         | 阴性,培养基不变色  |
| 山梨醇发酵管  | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h     | 肺炎克雷伯氏菌 CMCC(B)46117                | 定性                      | 阳性,培养基变黄色  |
|         |    |      |      |                        | 宋内志贺氏菌 CMCC(B)51592                 |                         | 阴性,培养基颜色不变 |
| 棉籽糖     | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h     | 肺炎克雷伯氏菌 CMCC(B)46117                | 定性                      | 阳性,培养基呈黄色  |
|         |    |      |      |                        | 普通变形菌 CMCC(B)49027                  |                         | 阴性,培养基颜色不变 |
| 黏液酸利用试验 | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h~48 h    | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922 | 定性                      | 阳性,培养基呈黄色  |
|         |    |      |      |                        | 福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572                 |                         | 阴性,培养基颜色不变 |
| 含饮牛乳培养基 | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 46℃±0.5℃<br>2 h与5 h均观察 | 产气荚膜梭菌 CMCC(B)64724<br>或 ATCC 13124 | 定性(接种生长旺盛的 FT 培养液 1 mL) | 暴烈发酵       |
|         |    |      |      |                        | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922 |                         | 不发酵        |
| 无盐陈水    | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h     | 霍乱弧菌 CICC 23794                     | 定性                      | 生长良好,浑浊    |
|         |    |      |      |                        | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802  |                         | 不生长,澄清     |
| 3%氯化钠陈水 | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h     | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802  | 定性                      | 生长良好,浑浊    |
|         |    |      |      |                        | 创伤弧菌 CMCC(B)17244<br>或 ATCC 27562   |                         | 生长良好,浑浊    |

表 F.7 鉴定培养基和实验试剂质量控制标准 (续)

| 培养基             | 状态 | 功能分类 | 质控指标 | 培养条件                                           | 测试菌株*                              | 方法 | 质控评定标准       |
|-----------------|----|------|------|------------------------------------------------|------------------------------------|----|--------------|
| 6%氯化钠胨水         | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h                             | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802 | 定性 | 生长良好, 浑浊     |
|                 |    |      |      |                                                | 嗜水气单胞菌 CMCC(B)10506                |    | 不生长, 澄清      |
| 8%氯化钠胨水         | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h                             | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802 | 定性 | 生长良好, 浑浊     |
|                 |    |      |      |                                                | 创伤弧菌 CMCC(B)17244<br>或 ATCC 27562  |    | 不生长, 澄清      |
| 10%氯化钠胨水        | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h                             | 溶藻弧菌 CMCC(B)20100<br>或 ATCC 33787  | 定性 | 生长良好, 浑浊     |
|                 |    |      |      |                                                | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802 |    | 不生长, 澄清      |
| 3.0%氯化钠甘露醇      | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h~48 h                            | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802 | 定性 | 阳性, 培养基变黄色   |
|                 |    |      |      |                                                | 普通变形菌 CMCC(B)49027                 |    | 阴性, 培养基颜色不变  |
| 3.0%氯化钠赖氨酸脱羧酶   | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃,<br>24 h~48 h<br>以灭菌液体<br>石蜡覆盖培<br>养基表面 | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802 | 定性 | 阳性, 培养基变紫色   |
|                 |    |      |      |                                                | 普通变形菌 CMCC(B)49027                 |    | 阴性, 培养基变黄色   |
| 3.0%氯化钠氨基酸脱羧酶对照 | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h~48 h                            | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802 | 定性 | 生长良好, 培养基变黄色 |
|                 |    |      |      |                                                | 普通变形菌 CMCC(B)49027                 |    | 生长良好, 培养基变黄色 |

表 F.7 鉴定培养基和实验试剂质量控制标准 (续)

| 培养基                | 状态  | 功能分类 | 质控指标 | 培养条件                | 测试菌株*                                | 方法 | 质控评定标准                                                                        |
|--------------------|-----|------|------|---------------------|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 七叶苷发酵管             | 液体  | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h  | 肺炎克雷伯氏菌 CMCC(B)46117                 | 定性 | 阳性,培养基变棕黑色                                                                    |
|                    |     |      |      |                     | 奇异变形菌 CMCC(B)49005                   |    | 阴性,培养基颜色不变                                                                    |
|                    |     |      |      |                     | 产气克雷伯氏菌 CMCC(B)45108<br>或 ATCC 13048 |    | MR 试验阴性,滴加 MR 试剂 1 滴培养基呈黄色                                                    |
| 3.0% 氯化钠 MR-VP 培养基 | 液体  | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>48 h±2 h  | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802   | 定性 | MR 试验阳性,滴加 MR 试剂 1 滴培养基呈红色;<br>V-P 试验阴性,滴加 0.6 mL 甲液及 0.2 mL 乙液,培养 4 h 培养基不变色 |
|                    |     |      |      |                     | 溶藻弧菌 CMCC(B)20100<br>或 ATCC 33787    |    | V-P 试验阳性,滴加 0.6 mL 甲液及 0.2 mL 乙液,培养 4 h 培养基呈红色                                |
|                    |     |      |      |                     | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922  |    | 阳性,培养基变黄色                                                                     |
| 乳糖发酵培养基            | 液体  | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h  | 肠沙门氏菌肠炎种伤寒血清型<br>CMCC(B)50071        | 定性 | 阴性,培养基颜色不变                                                                    |
|                    |     |      |      |                     | 弗氏柠檬酸杆菌 CMCC(B)48098<br>或 ATCC 43864 |    | 生长良好,培养基浑浊                                                                    |
| Koser 氏柠檬酸盐肉汤      | 液体  | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>18 h~96 h | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922  | 定性 | 不生长,培养基澄清                                                                     |
|                    |     |      |      |                     | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922  |    | 硫化氢-动力+/-靛基质+                                                                 |
| SIM 动力培养基          | 半固体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h~48 h | 肠沙门氏菌肠炎种伤寒血清型 CMCC(B)50071           | 定性 | 硫化氢+/-动力+靛基质-                                                                 |
|                    |     |      |      |                     | 蜡样芽孢杆菌 CMCC(B)63303<br>或 ATCC 10206  |    | 阳性,扩散生长                                                                       |
| 动力培养基              | 半固体 | 鉴定   | 生化特性 | 30℃±1℃<br>48 h±2 h  | 草状芽孢杆菌 CICC 24780<br>或 ATCC 10206    | 定性 | 阴性,沿穿刺线生长                                                                     |
|                    |     |      |      |                     |                                      |    |                                                                               |

表 F.7 鉴定培养基和实验试剂质量控制标准 (续)

| 培养基               | 状态 | 功能分类 | 质控指标 | 培养条件               | 测试菌株*                               | 方法                                                                   | 质控评定标准                         |
|-------------------|----|------|------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 明胶培养基             | 固体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h | 铜绿假单胞菌 CMCC(B)10901<br>或 ATCC 9027  | 定性                                                                   | 2℃~8℃呈液态                       |
|                   |    |      |      |                    | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922 |                                                                      | 2℃~8℃呈固态                       |
| 兔血浆               | 固体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>4 h~6 h  | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538 | 定性<br>(接种培养<br>18 h~<br>24 h 的新<br>鲜测试菌<br>株肉汤<br>0.2 mL~<br>0.3 mL) | 血浆凝固                           |
|                   |    |      |      |                    | 表皮葡萄球菌 CMCC(B)26069                 |                                                                      | 血浆不凝固                          |
| 酪蛋白琼脂             | 固体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h | 蜡样芽孢杆菌 CMCC(B)63303                 | 定性                                                                   | 菌落周围有透明圈,培养基颜色由绿变蓝             |
|                   |    |      |      |                    | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922 |                                                                      | 菌落周围没有透明圈,培养基由绿变蓝              |
| 缓冲动力-硝酸盐培养基       | 固体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h | 产气荚膜梭菌 CMCC(B)64724<br>或 ATCC 13124 | 定性                                                                   | 沿穿刺线生长,加硝酸盐还原试剂甲乙液<br>各 2 滴变红色 |
|                   |    |      |      |                    | 鲍氏不动杆菌 CMCC(B)25001                 |                                                                      | 沿穿刺线生长,加硝酸盐还原试剂甲乙液<br>各 2 滴不变色 |
|                   |    |      |      |                    | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922 |                                                                      | 扩散生长,加硝酸盐还原试剂甲乙液各 2<br>滴变红色    |
| 我妻氏血琼脂            | 固体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24 h±2 h | 副溶血弧菌 GDMCC 1.2936<br>或 ATCC 33847  | 定性<br>(点种接种)                                                         | 菌落周围有半透明 β 溶血环                 |
|                   |    |      |      |                    | 副溶血弧菌 CMCC(B)20033<br>或 ATCC 17802  |                                                                      | 无溶血                            |
| 血琼脂平板<br>哥伦比亚亚血琼脂 | 固体 | 鉴定   | 特异性  | 36℃±1℃<br>24 h±2 h | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538 | 定性<br>(划线接种)                                                         | 菌落周围有 β 溶血环                    |
|                   |    |      |      |                    | 肺炎链球菌 CMCC(B)33412                  |                                                                      | 菌落周围有 α 溶血环                    |

表 F.7 鉴定培养基和实验试剂质量控制标准 (续)

| 培养基                                | 状态 | 功能分类 | 质控指标 | 培养条件              | 测试菌株*                                     | 方法           | 质控评定标准       |
|------------------------------------|----|------|------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 胰酪陈大豆羊血琼脂<br>(TSSB)                | 固体 | 鉴定   | 特异性  | 36℃±1℃<br>24h±2h  | 蜡样芽孢杆菌 CMCC(B)63303                       | 定性<br>(划线接种) | 菌落周围有β溶血环    |
|                                    |    |      |      |                   | 肺炎链球菌 CMCC(B)33412                        |              | 菌落周围有α溶血环    |
| 蜜二糖                                | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24h±2h  | 阪崎克罗诺杆菌 CICC 21645<br>或 ATCC 29544        | 定性           | 阳性,培养基变黄     |
|                                    |    |      |      |                   | 小肠结肠炎耶尔森氏菌<br>CMCC(B)52204                |              | 阴性,培养基不变色    |
| 月桂基硫酸盐胰蛋白<br>陈肉汤-MUG (MUG-<br>LST) | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>18h~24h | 大肠埃希氏菌 O157:H7<br>CMCC(B)44939            | 定性           | 阴性,无荧光       |
|                                    |    |      |      |                   | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922       |              | 阳性,有荧光       |
| 革兰氏染色液                             | 液体 | 试验试剂 | 生化特性 | —                 | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26305<br>或 ATCC 6538       | 定性           | 革兰氏阳性,紫色球状菌体 |
|                                    |    |      |      |                   | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922       |              | 革兰氏阴性,红色杆状菌体 |
| 过氧化氢试剂                             | 液体 | 试验试剂 | 生化特性 | —                 | 单核细胞增生李斯特氏菌 CMCC(B)<br>54012 或 ATCC 19115 | 定性           | 阳性,产生气泡      |
|                                    |    |      |      |                   | 粪肠球菌 CMCC(B)32482<br>或 ATCC 29212         |              | 阴性,无气泡产生     |
| 氧化酶试剂                              | 纸片 | 试验试剂 | 生化特性 | —                 | 铜绿假单胞菌 CMCC(B)10901<br>或 ATCC 9027        | 定性           | 阳性,出现紫红色至紫黑色 |
|                                    |    |      |      |                   | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201<br>或 ATCC 25922       |              | 阴性,不变色       |
| 卫矛醇发酵管                             | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>24h±2h  | 肠沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型<br>CMCC(B)50976           | 定性           | 阳性,培养基变黄     |
|                                    |    |      |      |                   | 肠沙门氏菌肠炎亚种伤寒血清型<br>CMCC(B)50071            |              | 阴性,培养基不变色    |
| 丙二酸钠培养基                            | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>48h±2h  | 产气克雷伯氏菌 CMCC(B)45108<br>或 ATCC13048       | 定性           | 阳性,培养基变蓝     |
|                                    |    |      |      |                   | 普通变形菌 CMCC(B)49027                        |              | 阴性,培养基不变色    |

表 F.7 鉴定培养基和实验试剂质量控制标准 (续)

| 培养基           | 状态 | 功能分类       | 质控指标 | 培养条件                                     | 测试菌株*                               | 方法           | 质控评定标准                                         |
|---------------|----|------------|------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 哥伦比亚血琼脂       | 平板 | 鉴定         | 生化特性 | 42℃±1℃,<br>24 h~48 h,<br>微需氧培养           | 空肠弯曲菌 CMCC(B)22073<br>或 ATCC 33291  | 定性<br>(划线接种) | 生长良好                                           |
|               |    |            |      | 25℃±1℃,<br>44 h±4 h,<br>微需氧培养            |                                     |              | 不生长                                            |
|               |    |            |      | 42℃±1℃,<br>44 h±4 h,<br>需氧培养             |                                     |              | 不生长                                            |
| 马尿酸钠溶液(茚三酮试剂) | 液体 | 鉴定<br>试验试剂 | 生化特性 | 36℃±1℃,<br>水浴 2 h 或<br>36℃±1℃<br>培养箱 4 h | 空肠弯曲菌<br>CMCC(B)22073 或 ATCC 33291  | 定性           | 阳性,滴加茚三酮试剂 0.2 mL 在 36℃±1℃水浴锅或培养箱 10 min,出现深紫色 |
|               |    |            |      |                                          | 大肠弯曲杆菌<br>CMCC(B)22103 或 ATCC 43478 |              | 阴性,滴加茚三酮试剂 0.2 mL 在 36℃±1℃水浴锅或培养箱 10 min,黄色    |
| 吡啶乙酸酯纸片       | 纸片 | 试验试剂       | 生化特性 | —                                        | 空肠弯曲菌 CMCC(B)22073<br>或 ATCC 33291  | 定性           | 阳性,5 min~10 min 内出现深蓝色                         |
| 查氏培养基         | 固体 | 鉴定         | 生化特性 | 25℃±1℃<br>培养 5 d~14 d                    | 黑曲霉 CICC 2089                       | 定性           | 生长良好,白色菌丝,黑色孢子                                 |
| 麦芽汁琼脂         | 固体 | 鉴定         | 生化特性 | 25℃±1℃<br>培养 5 d~14 d                    | 黑曲霉 CICC 2089                       | 定性           | 生长良好,白色菌丝,黑色孢子                                 |
| 半固体琼脂         | 固体 | 鉴定         | 生化特性 | 36℃±1℃<br>培养 18 h~24 h                   | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201                 | 定性           | 有动力,扩散生长                                       |
|               |    |            |      |                                          | 福氏志贺氏菌 CMCC 51572                   |              | 无动力,沿穿刺线生长                                     |
|               |    |            |      | 26℃±1℃及<br>36℃±1℃<br>培养 18 h~24 h        | 小肠结肠炎耶尔森氏菌 CMCC(B)52204             |              | 26℃有动力,扩散生长,36℃无动力,沿接种线生长                      |

表 F.7 鉴定培养基和实验试剂质量控制标准（续）

| 培养基        | 状态 | 功能分类 | 质控指标 | 培养条件                                     | 测试菌株 <sup>a</sup>               | 方法 | 质控评定标准                          |
|------------|----|------|------|------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------|
| 乳糖-明胶培养基   | 固体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃培养<br>18h~24h                      | 产气荚膜梭菌 CMCC(B)64724             | 定性 | 乳糖阳性,培养基变黄;明胶阳性,培养基<br>4℃呈液态    |
|            |    |      |      |                                          | 肠沙门氏菌肠炎亚种伤寒<br>血清型 CMCC(B)50071 |    | 乳糖阴性,培养基红色不变;明胶阴性,培<br>养基 4℃呈固态 |
| 硫酸锰营养琼脂    | 固体 | 鉴定   | 生化特性 | 30℃±1℃<br>培养 24h±2h,<br>然后室温放<br>置 3d~4d | 蜡样芽孢杆菌 CMCC(B)63303             | 定性 | 生长良好,镜检有芽孢,无伴胞晶体                |
| 溶菌酶营养肉汤    | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>培养 24h~48h                     | 蜡样芽孢杆菌 CMCC(B)63303             | 定性 | 阳性,浑浊                           |
|            |    |      |      |                                          | 枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63542             | 定性 | 阴性,澄清                           |
| 葡萄糖琼脂      | 固体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>培养 24h±2h                      | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201             | 定性 | 阳性,变黄                           |
|            |    |      |      |                                          | 支气管肺炎鲍特氏菌 CMCC(B)40001          |    | 阴性,紫色                           |
| 卵黄琼脂       | 固体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>培养 24h±2h                      | 蜡样芽孢杆菌 CMCC(B)63303             | 定性 | 阳性,菌落周围有晕环                      |
|            |    |      |      |                                          | 枯草芽孢杆菌 CMCC 63542               |    | 阴性,菌落周围无晕环                      |
| β-半乳糖苷酶培养基 | 固体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>培养 18h~24h                     | 宋内氏志贺氏菌<br>CMCC(B)51592         | 定性 | 阳性,培养基呈深黄色                      |
|            |    |      |      |                                          | 福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572             |    | 阴性,培养基呈无色                       |
| 苦杏仁苷       | 液体 | 鉴定   | 生化特性 | 36℃±1℃<br>培养 24h±2h                      | 阪崎克罗诺杆菌<br>CICC 21645           | 定性 | 阳性,培养基呈黄色                       |
|            |    |      |      |                                          | 福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572             |    | 阴性,培养基不变或变为橙红色                  |

<sup>a</sup> A 表示产酸,培养基变黄。  
<sup>b</sup> K 表示产碱,培养基变红。

表 F.8 分子生物学检验实验试剂质量控制标准

| 试剂                | 功能分类 | 测试菌(毒)株                                       | 方法 | 质控评定标准                                                                                    |
|-------------------|------|-----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 致泻大肠埃希氏菌 PCR 检测试剂 | 鉴定   | 肠道致病性大肠埃希氏菌(EPEC)CMCC(B)43206                 | 定性 | <i>uidA</i> (阳性)、 <i>escV</i> (阳性)、 <i>eae</i> (阳性)、 <i>bfpB</i> (阳性)                     |
|                   |      | 肠道出血性大肠埃希氏菌(EHEC)CMCC(B)43207                 | 定性 | <i>uidA</i> (阳性)、 <i>escV</i> (阳性)、 <i>eae</i> (阳性)、 <i>stx</i> 1 (阳性)、 <i>stx</i> 2 (阳性) |
|                   |      | 产志贺毒素大肠埃希氏菌(STEC)/大肠埃希氏菌 O157:H7 CMCC(B)44939 | 定性 | <i>uidA</i> (阳性)、 <i>escV</i> (阳性)、 <i>eae</i> (阳性)、 <i>stx</i> 1 (阳性)、 <i>stx</i> 2 (阳性) |
|                   |      | 肠道侵袭性大肠埃希氏菌(EIEC)CMCC(B)44840                 | 定性 | <i>invE</i> (阳性)、 <i>ipaH</i> (阳性)                                                        |
|                   |      | 产肠毒素大肠埃希氏菌(ETEC)CMCC(B)43208                  | 定性 | <i>lt</i> (阳性)、 <i>stp</i> (阳性)、 <i>sth</i> (阳性)                                          |
|                   |      | 肠道集聚性大肠埃希氏菌(EAEC)CMCC(B)44841                 | 定性 | <i>astA</i> (阳性)、 <i>aggR</i> (阳性)、 <i>pic</i> (阳性)                                       |
|                   |      | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 (阴性对照)                    | 定性 | 相关基因阴性                                                                                    |
| 肉毒梭菌毒素基因 PCR 检测试剂 | 检测   | 生孢梭菌 CMCC(B)64942 (阴性对照)                      | 定性 | 相关毒素基因阴性                                                                                  |
|                   |      | 阳性对照试剂(携带目的毒素基因片段的质粒或 DNA)                    | 定性 | 相关毒素基因阳性                                                                                  |
| 诺如病毒 RT-PCR 检测试剂  | 检测   | 门哥病毒 CMCC(V)07000 或采用其他等效的过程控制病毒              | 定性 | 提取效率>1%。                                                                                  |
|                   |      | 外加扩增控制 RNA                                    | 定性 | 阳性,抑制指数<2                                                                                 |
| 创伤弧菌 PCR 检测试剂     | 检测   | 溶藻弧菌 CMCC(B)20100                             | 定性 | <i>vvhA</i> (阴性)                                                                          |
|                   |      | 创伤弧菌 CMCC(B)17244                             | 定性 | <i>vvhA</i> (阳性)                                                                          |

附录 G  
测试菌株

测试菌株中文名、拉丁名及编号见表 G.1。

表 G.1 测试菌株中文名、拉丁名及编号一览表

| 序号 <sup>a</sup> | 中文名                              | 拉丁名                                                                                  | CMCC 编号 <sup>b</sup> | CICC 编号 <sup>c</sup> | GDMCC 编号 <sup>d</sup> |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1               | 阪崎克罗诺杆菌                          | <i>Cronobacter sakazakii</i>                                                         | CMCC(B)45417         | CICC 21645           | GDMCC 1.2510          |
| 2               | 鲍氏不动杆菌                           | <i>Acinetobacter baumannii</i>                                                       | CMCC(B)25001         | —                    | —                     |
| 3               | 表皮葡萄球菌                           | <i>Staphylococcus epidermidis</i>                                                    | CMCC(B)26069         | —                    | —                     |
| 4               | 产肠毒素大肠埃希氏菌(ETEC)                 | Enterotoxigenic <i>Escherichia coli</i> (ETEC)                                       | CMCC(B)43208         | CICC 25101           | GDMCC 1.2970          |
| 5               | 产气荚膜梭菌                           | <i>Clostridium perfringens</i>                                                       | CMCC(B)64724         | CICC 25011           | GDMCC 1.2357          |
| 6               | 产气克雷伯氏菌(产气肠杆菌)                   | <i>Klebsiella aerogenes</i> ( <i>Enterobacter aerogenes</i> )                        | CMCC(B)45108         | CICC 25014           | GDMCC 1.2340          |
| 7               | 肠道出血性大肠埃希氏菌(EHEC)                | Enterohemorrhagic <i>Escherichia coli</i> (EHEC)                                     | CMCC(B)43207         | CICC 25043           | GDMCC 1.2953          |
| 8               | 肠道集聚性大肠埃希氏菌(EAEC)                | Enteroggregative <i>Escherichia coli</i> (EAEC)                                      | CMCC(B)44841         | CICC 25044           | GDMCC 1.3004          |
| 9               | 肠道侵袭性大肠埃希氏菌(EIEC)                | Enteroinvasive <i>Escherichia coli</i> (EIEC)                                        | CMCC(B)44840         | CICC 25100           | GDMCC 1.2987          |
| 10              | 肠道致病性大肠埃希氏菌(EPEC)                | Enteropathogenic <i>Escherichia coli</i> (EPEC)                                      | CMCC(B)43206         | CICC 25042           | GDMCC 1.2834          |
| 11              | 大肠埃希氏菌 O157:H7/产志贺毒素大肠埃希氏菌(STEC) | <i>Escherichia coli</i> O157:H7/Shiga toxin-producing <i>Escherichia coli</i> (STEC) | CMCC(B)44939         | CICC 25013           | GDMCC 1.2702          |
| 12              | 肠沙门氏菌肠炎种                         | <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i>                                    | CMCC(B)50335         | —                    | —                     |
| 13              | 肠沙门氏菌肠炎种伤寒血清型                    | <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Typhi                      | CMCC(B)50071         | —                    | —                     |
| 14              | 肠沙门氏菌肠炎种鼠伤寒血清型                   | <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Typhimurium                | CMCC(B)50976         | CICC 25045           | GDMCC 1.3028          |
| 15              | 创伤弧菌                             | <i>Vibrio vulnificus</i>                                                             | CMCC(B)17244         | CICC 25009           | GDMCC 1.2459          |
| 16              | 大肠埃希氏菌                           | <i>Escherichia coli</i>                                                              | CMCC(B)43201         | CICC 25012           | GDMCC 1.2425          |
|                 |                                  |                                                                                      | CMCC(B)44102         | CICC24106            | GDMCC 1.223           |

表 G.1 测试菌株中文名、拉丁名及编号一览表 (续)

| 序号 <sup>a</sup> | 中文名                | 拉丁名                              | CMCC 编号 <sup>b</sup> | CICC 编号 <sup>c</sup> | GDMCC 编号 <sup>d</sup> |
|-----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 17              | 大肠弯曲杆菌             | <i>Campylobacter coli</i>        | CMCC(B)22103         | CICC 25027           | GDMCC 1.2585          |
| 18              | 单核细胞增生李斯特氏菌        | <i>Listeria monocytogenes</i>    | CMCC(B)54012         | CICC 25021           | GDMCC 1.2408          |
| 19              | 肺炎克雷伯氏菌            | <i>Klebsiella pneumoniae</i>     | CMCC(B)46117         | —                    | —                     |
| 20              | 肺炎链球菌              | <i>Streptococcus pneumoniae</i>  | CMCC(B)33412         | CICC 25030           | GDMCC 1.2749          |
| 21              | 支气管炎鲍特氏菌           | <i>Bordetella bronchiseptica</i> | CMCC(B)40001         | —                    | —                     |
| 22              | 粪肠球菌               | <i>Enterococcus faecalis</i>     | CMCC(B)32482         | CICC 25019           | GDMCC 1.2493          |
| 23              | 弗氏柠檬酸杆菌            | <i>Citrobacter freundii</i>      | CMCC(B)48098         | CICC 25015           | GDMCC 1.2619          |
| 24              | 福氏志贺氏菌             | <i>Shigella flexneri</i>         | CMCC(B)51572         | —                    | —                     |
| 25              | 副溶血弧菌              | <i>Vibrio parahaemolyticus</i>   | CMCC(B)20033         | CICC 25008           | GDMCC 1.2391          |
| 26              | 副溶血弧菌 <sup>e</sup> | <i>Vibrio parahaemolyticus</i>   | CMCC(B)20035         | CICC 25029           | GDMCC 1.2936          |
| 27              | 黑曲霉                | <i>Aspergillus niger</i>         | CMCC(F)98029         | CICC 2089            | GDMCC 1.2374          |
| 28              | 霍乱弧菌               | <i>Vibrio cholerae</i>           | CMCC(B)17247         | CICC 23794           | GDMCC 1.2719          |
| 29              | 艰难梭菌               | <i>Clostridium difficile</i>     | CMCC(B)64967         | CICC 25028           | GDMCC 1.2602          |
| 30              | 溶藻弧菌               | <i>Vibrio alginolyticus</i>      | CMCC(B)20100         | CICC 25007           | GDMCC 1.2561          |
| 31              | 金黄色葡萄球菌            | <i>Staphylococcus aureus</i>     | CMCC(B)26305         | CICC 25018           | GDMCC 1.2442          |
| 32              | 空肠弯曲菌              | <i>Campylobacter jejuni</i>      | CMCC(B)22073         | CICC 25010           | GDMCC 1.2544          |
| 33              | 枯草芽孢杆菌             | <i>Bacillus subtilis</i>         | CMCC(B)63542         | CICC 25023           | GDMCC 1.2653          |
| 34              | 蜡样芽孢杆菌             | <i>Bacillus cereus</i>           | CMCC(B)63303         | —                    | —                     |
| 35              | 痢疾志贺氏菌             | <i>Shigella dysenteriae</i>      | CMCC(B)51105         | —                    | —                     |
| 36              | 酿酒酵母               | <i>Saccharomyces cerevisiae</i>  | CMCC(F)98017         | CICC 33471           | GDMCC 2.258           |
| 37              | 酿脓链球菌              | <i>Streptococcus pyogenes</i>    | CMCC(B)32210         | CICC 10373           | GDMCC 1.245           |
| 38              | 普通变形菌              | <i>Proteus vulgaris</i>          | CMCC(B)49027         | —                    | —                     |
| 39              | 奇异变形菌              | <i>Proteus mirabilis</i>         | CMCC(B)49005         | —                    | —                     |

表 G.1 测试菌株中文名、拉丁名及编号一览表 (续)

| 序号 <sup>a</sup> | 中文名                     | 拉丁名                                                                                              | CMCC 编号 <sup>b</sup> | CICC 编号 <sup>c</sup> | GDMCC 编号 <sup>d</sup> |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 40              | 瑞士乳杆菌                   | <i>Lactobacillus helveticus</i>                                                                  | —                    | CICC 6032            | —                     |
| 41              | 生孢梭菌                    | <i>Clostridium sporogenes</i>                                                                    | CMCC(B)64942         | CICC 25026           | GDMCC 1.2734          |
| 42              | 嗜热链球菌                   | <i>Streptococcus thermophilus</i>                                                                | —                    | CICC 6038            | —                     |
| 43              | 嗜水气单胞菌                  | <i>Aeromonas hydrophila</i>                                                                      | CMCC(B)10506         | CICC 25017           | GDMCC 1.2306          |
| 44              | 宋内氏志贺氏菌                 | <i>Shigella sonnei</i>                                                                           | CMCC(B)51592         | —                    | —                     |
| 45              | 铜绿假单胞菌                  | <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                                                                    | CMCC(B)10901         | CICC 25016           | GDMCC 1.2476          |
| 46              | 英诺克李斯特氏菌                | <i>Listeria innocua</i>                                                                          | CMCC(B)54103         | CICC 25020           | GDMCC 1.2527          |
| 47              | 小肠结肠炎耶尔森氏菌              | <i>Yersinia enterocolitica</i>                                                                   | CMCC(B)52204         | —                    | —                     |
| 48              | 蕈状芽孢杆菌                  | <i>Bacillus mycoides</i>                                                                         | CMCC(B)63549         | CICC 24780           | GDMCC 1.2323          |
| 49              | 长双歧杆菌婴儿亚种(婴儿双歧杆菌)       | <i>Bifidobacterium longum</i> subsp. <i>infantis</i> ( <i>Bifidobacterium infantis</i> )         | —                    | CICC 6069            | —                     |
| 50              | 植物乳杆菌(植物乳植物杆菌)          | <i>Lactobacillus plantarum</i> ( <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> )                          | CMCC(B)34130         | CICC 25024           | GDMCC 1.2685          |
| 51              | 门哥病毒                    | <i>Mengovirus</i>                                                                                | CMCC(V)07000         | CICC 80005           | GDMCC 90001           |
| 52              | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌(椰毒假单胞菌酵米面亚种) | <i>Burkholderia gladioli</i> ( <i>Pseudomonas cocovenenans</i> subsp. <i>farino fermentans</i> ) | CMCC(B)10802         | CICC 25108           | GDMCC 1.2670          |

<sup>a</sup> 为方便检验实验室菌种获取,同一序号菌种如出现不同菌种编号,全部为同一菌株在三家菌种保藏管理中心同时注册获得。

<sup>b</sup> CMCC 代表中国医学细菌保藏管理中心。

<sup>c</sup> CICC 代表中国工业微生物菌种保藏管理中心。

<sup>d</sup> GDMCC 代表广东省微生物菌种保藏管理中心。

<sup>e</sup> 该菌株为我妻氏平板溶血阳性测试用菌株。

## 附录 H

### 螺旋平板法

#### H.1 一般要求

使用螺旋接种仪将样品接种在平板上。样品接种后,菌落即分布在螺旋轨迹上,随半径的增加分布得越来越稀。采用特殊的计数栅格,自平板外周向中央对平皿上的菌落进行计数,即可得到样品中微生物的数量。

#### H.2 实验步骤

取制备好的适宜稀释度的样品稀释液,以选定的模式接种于试验所用平板,每个稀释度接种两块平板,接种每一个样品前后均按仪器设定程序对螺旋接种仪进行清洗消毒。

按相同接种模式接种悬浮液作为空白对照。

将平板按标准方法中规定的培养时间和温度进行培养后,计数每个平板菌落数,并记录下来。

#### H.3 菌落总数的计算和记录

平板上菌落数符合菌落计数仪规定计数范围的为合适范围。如果两个稀释度的四个平板菌落数均在合适范围内,则将四个平板菌落数的平均值作为每克(毫升)样品中的菌落数;如果只有一个稀释度的两个平板菌落数在合适范围内,则将这两个平板菌落数的平均值作为每克(毫升)样品中的菌落数。

当低稀释度的两个平板菌落数都少于合适范围的下限时,计算这一稀释度两个平板菌落数的平均值作为每克(毫升)样品中的菌落数。给这个数注上星号(\*),表明该数是从菌落数在计数范围之外的平板估计所得。当所有平板上的菌落数都超过合适范围的上限时,计算高稀释度两个平板菌落数的平均值作为每克(毫升)样品中的菌落数,给这个数注上星号(\*)。如果所有稀释度的平板都没有菌落,则以小于1乘以稀释倍数和接种体积作为每克(毫升)样品中的菌落数,给这个数注上星号(\*)。

记录时,只有在换算到每克(毫升)样品中的菌落数时,才能定下两位有效数字,第三位数字采用四舍五入的方法记录。也可将样品的菌落数记录为10的指数形式。

#### H.4 结果的表述

根据 H.3 归档计算出每克(毫升)样品的菌落数,固体样品以 CFU/g 为单位,液体样品以 CFU/mL 为单位。